

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

สัญญาเลขที่ ...๑๑/๒๕๖๗.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ตำบล/แขวง แวงนาง อำเภอ/เขต เมืองมหาสารคาม

จังหวัด มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่าง จังหวัดมหาสารคาม โดย นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๓๐๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จะซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น ๘-๙ ถนน สุขุมวิท

ตำบล/แขวง คลองเตย อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย นายเศวต เชิงชวน ผู้รับมอบอำนาจช่วงจาก นางสาวจินดารัตน์ ริวทอง

ผู้รับมอบอำนาจจาก นายลักขมณ ชุศิริ และ นายวราธร แสงเดือน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (และหนังสือมอบอำนาจช่วงลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖.....)

แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้จะขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า..... -

อยู่เลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต

จังหวัด) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จะขาย” อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาได้ตกลงกัน

มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงจะซื้อจะขาย

ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขายวัสดุการแพทย์ รายการ T-WAY (๓ WHITE) ยี่ห้อ BD Connecta ผลิตภัณฑ์ประเทศสวีเดน จำนวน ๖๑,๐๐๐ อันๆ ละ ๘.๔๙ บาท รวมเป็นเงิน ๕๑๗,๘๙๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จำนวนที่ผู้จะซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราวๆ ไป มีกำหนดเวลา ๓๖๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้จะขายรับจะจัดหาสิ่งของที่ผู้จะขายตามวรรคหนึ่ง เตรียมไว้ให้แก่ผู้จะซื้อได้อย่างเพียงพอตามจำนวนที่คู่สัญญาได้ตกลงประมาณการไว้ในภาคผนวก.....๑..... แนบท้ายสัญญานี้ แต่ผู้จะซื้ออาจสั่งซื้อจริงมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนประมาณการดังกล่าวก็ได้

ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

(นายเศวต เชิงชวน)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักวิชาการพัสดุ

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้จะขายรับรองว่าสิ่งของที่จะขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒.....

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้จะขายรับรองว่าเมื่อตรวจสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา	จำนวน	๒	หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	๓	หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ แคตตาล็อก	จำนวน	๑๔	หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ การจัดทำแผนการทำงาน	จำนวน	๑	หน้า
๓.๕ ผนวก ๕ ใบชี้แจงและยืนยันการเสนอราคา	จำนวน	๒	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้จะขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จะซื้อ คำวินิจฉัยของผู้จะซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้จะขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้จะซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การออกใบสั่งซื้อแต่ละคราว

ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการพร้อมกันก็ได้ใน ปริมาณแต่ละรายการคราวละอย่างมาไม่เกิน(.....) หรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า.....(.....) โดยระบุปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่ผู้จะขายจะต้องส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราว ทั้งนี้ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อ มอบให้แก่ผู้จะขายล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อไม่น้อยกว่า.....๓๐.....(.....สามสิบ.....) วัน

ข้อ ๕. การส่งมอบ

ผู้จะขายสัญญาว่าจะส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อตามปริมาณ สถานที่และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง พร้อมทั้งหีบห่อ หรือเครื่องรัดพันผูกให้เรียบร้อย

ข้อ ๖. การตรวจรับ

เมื่อผู้จะซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งซื้อในแต่ละคราว แล้ว ผู้จะซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้จะขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งซื้อผู้จะซื้อทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้จะขายจะต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และ นำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งซื้อด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้จะขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุผลขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือตัดค่าปรับไม่ได้

ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

(นายเสวต เจริญโน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญญา คำพอ)

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการพัสดุ

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ซื้อจะชำระเงินค่าสิ่งของที่คำนวณตามปริมาณที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๑ แนบท้ายสัญญานี้ให้แก่ผู้ขายภายใน.....๓๐.....(.....สามสิบ.....) วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้แสดงหลักฐานการรับมอบตามข้อ ๖ ให้แก่ผู้ซื้อ

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายชื่อ.....ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด..... สาขา.....กรุงเทพฯ ๐๐๐๑.....
ชื่อบัญชี.....บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด.....ประเภทบัญชี.....กระแสรายวัน.....
เลขที่บัญชี.....๐๐๑-๐๘๘๒๕๓-๐๐๑.....ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนดแล้วแต่กรณี)

ข้อ ๘. การรับประกันการชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา.....๑.....(.....หนึ่ง.....) ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบโดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕.....(.....สิบห้า.....) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นหากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขายไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้อง ผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญาของ.....ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ ๖๖๔๙๐๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๘๙๕,- บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน).....ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....๕.....(.....ห้า.....) ของราคาประมาณการตามข้อ ๑ มามอบไว้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ลงชื่อ.....ผู้ขาย
(นายเสวต เชิงชวน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....พยาน
(นางกัญดา คำพอ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางวาสนา ไชยงาม)
นักวิชาการพัสดุ

กรณีผู้จะขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้จะขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้จะขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้จะขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้จะขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้จะขายตลอดอายุสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้จะขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้จะขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน.....๗.....(.....เจ็ด.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้จะขายนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้จะซื้อจะคืนให้เมื่อผู้จะขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

ในกรณีที่ผู้จะซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้จะซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามสัญญาข้อ ๙ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้จะซื้อเห็นสมควรและถ้าผู้จะซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณีภายในกำหนด ๑.....(.....หนึ่ง.....) เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้จะขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๑. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๑๐ ผู้จะขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐%.....(.....ศูนย์จุดสองศูนย์.....) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบ กำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ หรือจนถึงวันที่ผู้จะซื้อได้สั่งซื้อสิ่งของตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอื่น ในกรณีนี้ผู้จะขายยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วย ซึ่งผู้จะขายตกลงให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าปรับและราคาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจากราคาส่งของตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้ หรือให้ผู้จะซื้อเรียกร้องจากผู้จะขายตามสัญญาข้อ ๑๒ หรือจะเรียกร้องจากหลักประกันสัญญาตามข้อ ๙ ก็ได้ ตามที่ผู้จะซื้อจะเห็นสมควร

ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

(นายเศวต เจริญโน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญญา คำพอ)

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการพัสดุ

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงจะซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้จะขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้ได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้จะซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้จะซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกเงื่อนจากรณาคารถูกออก หนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ ๙ กับเรียกเงื่อนให้ชดเชยราคาที่พักขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๐ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้จะซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้จะขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อแล้วผู้จะซื้อ มีสิทธิที่จะปรับผู้จะขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้จะซื้อ ผู้จะขายต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้จะซื้อ โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....๓๐.....(.....สามสิบ.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ หากผู้จะขาย ไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้จะซื้อ มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อ จะขายที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้จะขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน ตามจำนวนค่าปรับค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายนั้นภายในกำหนด.....๓๐.....(.....สามสิบ.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผู้จะขายทั้งหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความรับผิดชอบ หรือความบกพร่องของ ฝ่ายผู้จะซื้อ หรือจากเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้จะขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้จะขาย ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้จะขายมีสิทธิขอขยายเวลาทำการ ตามสัญญาหรือขอลดหรืองดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้จะซื้อทราบภายใน.....๑๕.....(.....สิบห้า.....) วัน นับแต่วันที่เหตุอันสิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญญา คำพอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

(นายเศวต เชิงชวน)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักวิชาการพัสดุ

ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้จะขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญาเพื่อลดหรือลดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้จะซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายเวลาทำการตามสัญญาเพื่อลดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้จะซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๔. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อตามสัญญานี้เป็นสิ่งของของผู้จะขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้จะขายจะต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีธงเรือไทยหรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือส่งซื้อของดังกล่าวจากต่างประเทศเป็นแบบเอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือเป็นแบบอื่นใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้จะขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยแก่ผู้จะซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้จะขายจะต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้จะซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองข้างต้นให้แก่ผู้จะซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้จะซื้อก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้จะซื้อเมื่อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้จะขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

(นายเศวต เริงชวน)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวราสนา ไชยงาม)

นักวิชาการพัสดุ

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด อาคาร เฟลนิจิตเซ็นเตอร์ ชั้น ๘-๙ เลขที่ ๒ ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเขต คลองเตยจังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๖-๘๘๐๐ ต่อ ๒๑๓๕ โดย นายเสวต เชิงชวน ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ	รวมเป็นเงินผู้จะขาย	กำหนดส่ง
			ลงชื่อ.....ผู้จะขาย	(บาท)	มอบ
๑	T-WAY (๓ WHITE)	-	ลงชื่อ.....ผู้จะขาย	๕๑๗,๘๕๐.๐๐	๓๖๕
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๑๗,๘๕๐.๐๐	

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันจากผู้เสนอราคา ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา

.....กรรมการ

อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือจังหวัด อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ จังหวัด

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้นำพร้อมใบเสนอราคาดังนี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคาที่ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทที่ชื่อ.....ผู้จะขาย..... หรือการสมรภูมิร่วมกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคล หรืออันหนึ่งอันนั้นส่วน บริษัทใด.....ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

ลงชื่อ.....พยาน

เสนอมา ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๓๒:๑๒ น.

(นายเสวต เจริญโน)

ผู้รับมอบอำนาจช่วง

เลขที่โครงการ ๖๖๐๔๔๓๑๑๒๒๒

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๐๖๑๖๐๐๓๒๔๐๒

รหัสอ้างอิง OTP INBS

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๔๑๖๕๑๑

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

T-WAY (๓ WHITE)

จังหวัดมหาสารคาม

๑. ความต้องการ T-WAY (๓ WHITE ๑๐๐/กล่อง)

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมต่อในการให้สารน้ำหรือสารละลายหรือให้ยาผู้ป่วยทางหลอดเลือดได้มากกว่า ๑ ช่องทาง

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ วัสดุทำด้วยพลาสติก Medical grade ซึ่งแข็งแรง ทนต่อการแตกหักและมีลักษณะใส ทำให้มองเห็นสารละลาย ตะกอน สิ่งแปลกปลอมอื่นๆ หรือฟองอากาศได้รวดเร็ว

๓.๒ ก้านหมุนมี ๓ ก้าน บนก้านหมุนทั้ง ๓ ด้าน มีลูกศรบอกทิศทางการไหลของ ของเหลวอย่างชัดเจน สามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา

๓.๓ เมื่อหมุนแกนหมุนไปยังช่องทางที่ต้องการ จะมีระบบล็อก (Click lock) เพื่อแสดงให้เห็นว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแน่นอน ซึ่งไม่ทำให้สารน้ำรั่วซึมออกมา มีระบบล็อกเพื่อป้องกันการเปลี่ยนทิศทางได้ง่าย

๓.๔ ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็น Close system มีฝาจุกปิดปลายทั้ง ๓ ด้าน ป้องกันการปนเปื้อน

๓.๕ ปลายท่อด้านที่ใช้ต่อกับ IV catheter หรือ extension tube มีลักษณะเป็นเกลียวล็อก (Luer-lock) ต่อเข้าได้พอดีกับ set IV ที่ใช้ในโรงพยาบาล และสามารถต่อกันเองได้มากกว่า ๒ ตัว โดยไม่ต้องใช้

อุปกรณ์อื่นๆ ช่วย

๓.๖ เป็นชนิดผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว (Sterile)

ลงชื่อ.....พยาน

๓.๗ ใช้กับผู้ป่วยแล้วไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต

ลงชื่อ.....พยาน

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ต้องมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๒ บรรจุของละ ๑ อัน เปิดใช้งานสะดวก ปลอดภัยต่อการปนเปื้อน

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

SW

บริษัท ซูลลิค ฟาร์มา จำกัด

ชั้น 8-9 อาคารเพลิมินิตเซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 2656-9800 | โทรสาร +66 2656-9801 | ตู้ ปณ. 409 ปณ. บางรัก กทม. 10500

www.zuelligpharma.com

- ๔.๓ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก ISO ๑๓๔๘๕ ขึ้นในวันเสนอราคา
- ๔.๔ ผลการมีข้อความระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์สถานที่ผลิต เลขที่ผลิต และเดือน ปี ที่หมดอายุให้ชัดเจนและ
ต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
- ๔.๕ หากสินค้ามีการชำรุด เสียหาย หรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่
โดยไม่คิดมูลค่า
- ๔.๖ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผล
โรงพยาบาลมหาสารคามจะไม่รับพัสดุ หากผลิตภัณฑ์ชำรุด หรือเสื่อมสภาพลงก่อนหมดอายุการใช้งาน
ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนได้โดยไม่คิดมูลค่า
- ๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของ T-WAY จำนวน ๕๐ อัน และทางโรงพยาบาลมหาสารคาม จะไม่คืน
ตัวอย่างให้ผู้เสนอราคาและต้องผ่านการประเมินทุกข้อตามที่โรงพยาบาลมหาสารคามกำหนด โดยมี
เกณฑ์การประเมินดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ลงชื่อ.....	ผลการประเมิน		ผู้ให้ข้อมูล
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑.	วัสดุมีความแข็งแรง ทนต่อการแตกหัก	ลงชื่อ.....			ผู้จะขาย
๒.	ก้านหมุนมี ๓ ก้าน บนก้านหมุนทั้ง ๓ ด้าน มีลูกศรบอกทิศทาง การไหลของ ของเหลวอย่างชัดเจน สามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา	ลงชื่อ.....			พยาน
๓.	มีระบบล็อก (Click lock) เพื่อแสดงให้เห็นว่าอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ แน่นอนและมีระบบล็อกเพื่อป้องกันการเปลี่ยนทิศทางได้ง่าย				พยาน
๔.	เป็น Close system มีฝาจุปิดปลายทั้ง ๓ ด้าน ป้องกันการปนเปื้อน				
๕.	ปลายท่อด้านที่ใช้ต่อกับ IV catheter หรือ extension tube สามารถต่อเข้าได้พอดีกับ set iv ที่ใช้ในโรงพยาบาล และ สามารถต่อกันเองได้มากกว่า ๒ ตัว โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆช่วย				

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

SW

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยผู้ซื้อจะออกใบสั่งซื้อพัสดุในแต่ละคราวตามจำนวนที่ผู้ซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราวๆไป

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินบำรุงโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวงเงิน ๓,๐๖๘,๐๐๐.-บาท (สามล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑. BLOOD LINE SET จำนวน ๑๐,๓๖๐ ชุดๆละ ๒๕ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๓,๕๐๐.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒. BACTERIAL FILTER จำนวน ๓๐,๐๐๐ อันๆละ ๒๕ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. Triple Lumen ๗FR*๒๐ cm จำนวน ๑,๖๐๐ อันๆละ ๗๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

๔. T-WAY (๓ WHITE) จำนวน ๖๑,๐๐๐ อันๆละ ๘.๖๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๔,๖๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ลงชื่อ.....พยาน

ผู้ซื้อจะชำระเงินค่าสิ่งของตามวงเงินที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราวให้แก่ผู้ขาย นับแต่ผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาและตามวงเงินในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๑ ปีนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณนี้ เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
SW

บริษัท ซิแอลิก ฟาร์มา จำกัด

ชั้น 8-9 อาคารเพนซินิจิตเซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 2656-9800 | โทรสาร +66 2656-9801 | ตู้ ปณ. 409 ปณจ. บางรัก กทม. 10500

www.zuelligpharma.com

บัญชีรายการเอกสาร E-bidding โรงพยาบาลมหาสารคาม

รายการ	จำนวน
รายการที่ 4 T-WAY (3 WHITE)	
- หนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์	4 หน้า
- เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต ISO	4 หน้า
- แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะ.....	ผู้ซื้อ 6 หน้า
- Certificate of free sales	ผู้ขาย 3 หน้า
- หนังสือรับรองการตัวแทนจำหน่าย	ผู้ขาย 2 หน้า

****หมายเหตุ** กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อ

คุณแสวง เชิงชวน โทร.098-096-1894

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



รับรองบางส่วน
หนังสือรับรองประกอบกรนำเข้าเครื่องมือแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือเลขที่ SWE 6208575

13 ธันวาคม 2562

ได้พิจารณาหนังสือรับรองการขาย/หนังสือรับรองการขายและหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตแล้ว
ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531

ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท ซิลิค ฟาร์มา จำกัด

ชื่อผู้ผลิต : BECTON DICKINSON INDIA PRIVATE LIMITED

ผู้รับซื้อ
ผู้จำหน่าย
ลงชื่อ.....

ผู้ผลิตเพิ่มเติมตามแนบท้าย

หนังสือฉบับนี้ใช้ประกอบกับ ☒ หนังสือรับรองการขายเลขที่

ลงชื่อ..... Dnr: 5.8.2-2019-03447

ประเทศ Kingdom of Sweden

☒ หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตเลขที่.....ตามเอกสารแนบท้าย

สามารถใช้ประกอบกรนำเข้าเครื่องมือแพทย์จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2567



เงื่อนไข

- เมื่อปรากฏว่าประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์ห้ามขาย หรือมีการยกเลิกการรับรองระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์รายการใดตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ถือว่าการรับรองเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
- ห้ามนำเลขที่หนังสือไปประกาศโฆษณา
- ห้ามโฆษณาว่าได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ห้ามโฆษณาเครื่องมือแพทย์ก่อนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก/เพิกถอนหนังสือรับรองประกอบกรนำเข้าเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้ หากผู้นำเข้าไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว

หมายเหตุเพิ่มเติม

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการบันทึกเข้ามาทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

SW.

เอกสารแนบท้ายหนังสือเลขที่ SWE 6208575

เลขที่หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต

ชื่อผู้ผลิต BECTON DICKINSON INDIA PRIVATE
LIMITED

ประเทศ Republic of India

ISO เลขที่ 247911-2017-AQ-IND-NA-PS Rev. 1.0

ชื่อผู้ผลิต BECTON DICKINSON MEDICAL (S) PTE LTD

ประเทศ Republic of Singapore

ISO เลขที่ MD 81426

ชื่อผู้ผลิต BECTON, DICKINSON INFUSION THERAPY
SYSTEMS INC., S.A. DE C.V.

ประเทศ United Mexican States

ISO เลขที่ FM 673986

ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

SW.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

รายการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ตามหนังสือรับรองเลขที่ SWE 6208575

วันที่อนุมัติ 13/12/2562 วันที่หมดอายุ 8/1/2567

ความหมายของรหัส Owner

1 รหัส 13534 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ BECTON DICKINSON INFUSION THERAPY AB ประเทศ Sweden

ความหมายของรหัส manucl

1 รหัส 15696 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ BECTON DICKINSON INDIA PRIVATE LIMITED ประเทศ India

2 รหัส 112 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ BECTON DICKINSON MEDICAL (S) PTE LTD ประเทศ Singapore

3 รหัส 129 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ BECTON, DICKINSON INFUSION THERAPY SYSTEMS INC., S.A. DE C.V. ประเทศ Mexico

Owner	manucl	grpno	catno	offname	pdtname	desc	pageno	umdn	gmdn	RefitemNo
13534	112	MD 81426	391349	NEOFLO IV CANNULA	BD Neoflon I.V. Catheter 26GA-0.6 x 19mm-13ml/min	NEOFLO IV CANNULA	2	18637		6200112000210
13534	112	MD 81426	391350	NEOFLO IV CANNULA	BD Neoflon I.V. Catheter 24GA 0.7x19mm-13ml/min	NEOFLO IV CANNULA	2	18637		6200112000211
13534	112	MD 81426	391379	NEOFLO Pro IV CANNULA Instaflash	BD Neoflon Pro I.V. Catheter 26GA 19mm 14ml/min	NEOFLO Pro IV CANNULA Instaflash	4	18637		6200112000255
13534	112	MD 81426	391380	NEOFLO Pro IV CANNULA Instaflash	BD Neoflon Pro I.V. Catheter 24GA 19mm 19ml/min	NEOFLO Pro IV CANNULA Instaflash	4	18637		6200112000256
13534	129	MD 673986	394600	CONNECTA STOPCOCK	BD Connecta Stopcock	CONNECTA STOPCOCK	3	13803		6200129000091

MS

กรรมการ



กรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
 รายการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ตามหนังสือรับรองเลขที่ SWE 6208575

วันที่อนุมัติ 13/12/2562 วันที่หมดอายุ 8/1/2567

Owner	manucd	gmpno	catno	offname	pdtname	desc	pageno	umdn	gmdn	RefItemNo
13534	129	FM 673986	394926	CONNECTA STOPCOCK WITH EXTENSION TUBE	BD Connecta Stopcock With Extension Tube	CONNECTA STOPCOCK WITH EXTENSION TUBE	3	13803		6200129000105
13534	129	FM 673986	394995	CONNECTA STOPCOCK WITH EXTENSION TUBE	BD Connecta Stopcock With Extension Tube	CONNECTA STOPCOCK WITH EXTENSION TUBE	3	13803		6200129000111
13534	15696	247911-2017- AQ-IND-NA-PS Rev. 1.0	391451	VENFLON IV CANNULA	BD Venflon Catheter 22G (0.8x25mm)	VENFLON IV CANNULA	2	18637		6215696000022
13534	15696	247911-2017- AQ-IND-NA-PS Rev. 1.0	391452	VENFLON IV CANNULA	BD Venflon Catheter 20G (1.0x32mm)	VENFLON IV CANNULA	2	18637		6215696000023
13534	15696	247911-2017- AQ-IND-NA-PS Rev. 1.0	391454	VENFLON IV CANNULA	BD Venflon Catheter 17G (1.4x45mm)	VENFLON IV CANNULA	2	18637		6215696000025
13534	15696	247911-2017- AQ-IND-NA-PS Rev. 1.0	391455	VENFLON IV CANNULA	BD Venflon Catheter 16G (1.7x45mm)	VENFLON IV CANNULA	2	18637		6215696000026
13534	15696	247911-2017- AQ-IND-NA-PS Rev. 1.0	391457	VENFLON IV CANNULA	BD Venflon Catheter 18G (1.2x32mm)	VENFLON IV CANNULA	2	18637		6215696000028

MS

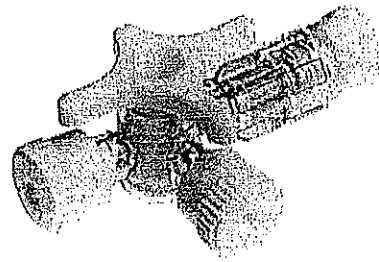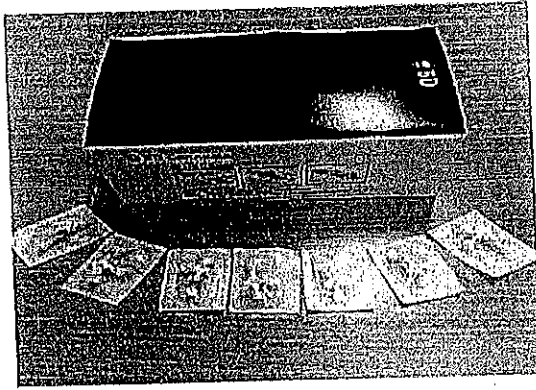

คุณลักษณะเฉพาะ T-WAY (3 WHITE)

BD Connecta (Three Way Stopcock)

วัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมต่อในการให้สารน้ำหรือสารละลายหรือให้ผู้ป่วยทางหลอดเลือด ได้มากกว่า 1 ช่องทาง
คุณลักษณะเฉพาะ

ตรงกับคุณลักษณะข้อ 3.1 ของ รพ.

1. วัสดุทำด้วยพลาสติก Medical Grade ชนิด Polycarbonate ซึ่งแข็งแรง และทนต่อการแตกหัก และทนต่อการให้สารละลายไขมัน (Lipid) ทนต่อการแตกหัก และมีลักษณะใส ทำให้มองเห็นสารละลายตะกอน สิ่งแปลกปลอมอื่นๆ หรือฟองอากาศได้รวดเร็ว

2. ก้านหมุนมี 3 ก้าน บนก้านหมุนทั้ง 3 ก้าน มีลูกศรบอกทิศทางการไหลของ ของเหลวอย่างชัดเจน สามารถหมุนได้ 360 องศา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้

ตรงกับคุณลักษณะข้อ 3.2 ของ รพ.

3. ปลายท่อด้านที่ใช้ต่อกับ IV Catheter หรือ Extention tube เป็นข้อต่อชนิด Luer lock สามารถใช้ได้กับ IV CATH ทุกยี่ห้อ ระหว่างการใช้งานไม่เลื่อนหลุดง่าย ไม่รั่วซึม และสามารถต่อกันเองได้มากกว่า 2 ตัว โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆช่วย

ตรงกับคุณลักษณะข้อ 3.5 ของ รพ.

4. ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็น Close system มีฝาจุกปิดปลายท่อ 3 ด้าน ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อ (Contamination)

ตรงกับคุณลักษณะข้อ 3.4 ของ รพ.

5. มีปลายสามทาง และมีลูกศรบอกทิศทางการไหลของเหลวอย่างชัดเจน

6. เมื่อหมุนแกนหมุนไปยังช่องทางที่ต้องการ จะมีจังหวะคลิก (Click lock) เพื่อแสดงให้ทราบว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแน่นอนซึ่งไม่ทำให้สารน้ำรั่วซึมออกมา มีระบบล็อกเพื่อป้องกันการเปลี่ยนทิศทางสารการได้ง่าย

ตรงกับคุณลักษณะข้อ 3.3 ของ รพ.

Zuellig Pharma Ltd.

8-9/F Ploenchit Center, 2 Sukhumvit Rd., Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

T +66 2 656 9800 | F +66 2 656 9801

www.zuelligpharma.com

.....กรรมการ
.....กรรมการ

SW

7. ปริมาตรคงค้าง (Priming Volume) 0.22 ml.
8. DBHP-free สามารถใช้กับยาเคมีบำบัดได้
9. Latex-free ปกติในผู้ป่วยที่แพ้ Latex
10. ระบุ Lot No. และวันหมดอายุชัดเจนในแต่ละบรรจุภัณฑ์
11. ขອງบรรจุ (Packaging) เป็นชนิด Tyvek Package ซึ่งแข็งแรงไม่แตกง่าย และกันน้ำได้ดี
12. บรรจุของละ 1 อัน เปิดใช้งานสะดวกปลอดภัยต่อการปนเปื้อน ตรงกับเงื่อนไขเฉพาะ ข้อ 4.2
13. ขนาดบรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง
14. ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว (Sterile) ทำให้ปราศจากเชื้อ โดย รังสี ตรงกับคุณสมบัติข้อ 3.5 ของ พ.ร.บ. ยา ผู้จะซื้อ
ลงชื่อ.....
15. ได้รับมาตรฐาน CE ลงชื่อ.....ผู้จะขาย
16. เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศเม็กซิโก ลงชื่อ.....พยาน
17. เวชภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ ตรงกับเงื่อนไขเฉพาะ ข้อ 4.1 พยาน
18. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO13485
19. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ตรงกับเงื่อนไขเฉพาะ ข้อ 4.1
20. หากเวชภัณฑ์มีการชำรุด เสียหาย หรือพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา ผู้เสนอราคายินยอมเปลี่ยนให้ใหม่
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

CONNECTA™ Plus 3


ให้คุณได้มากกว่า
3 way stopcock ตัวใน



BD


Indispensable to
human health

การเชื่อมต่อ.....ผู้ดูแล
การเชื่อมต่อ.....ผู้ดูแล
การเชื่อมต่อ.....ผู้ดูแล
การเชื่อมต่อ.....ผู้ดูแล

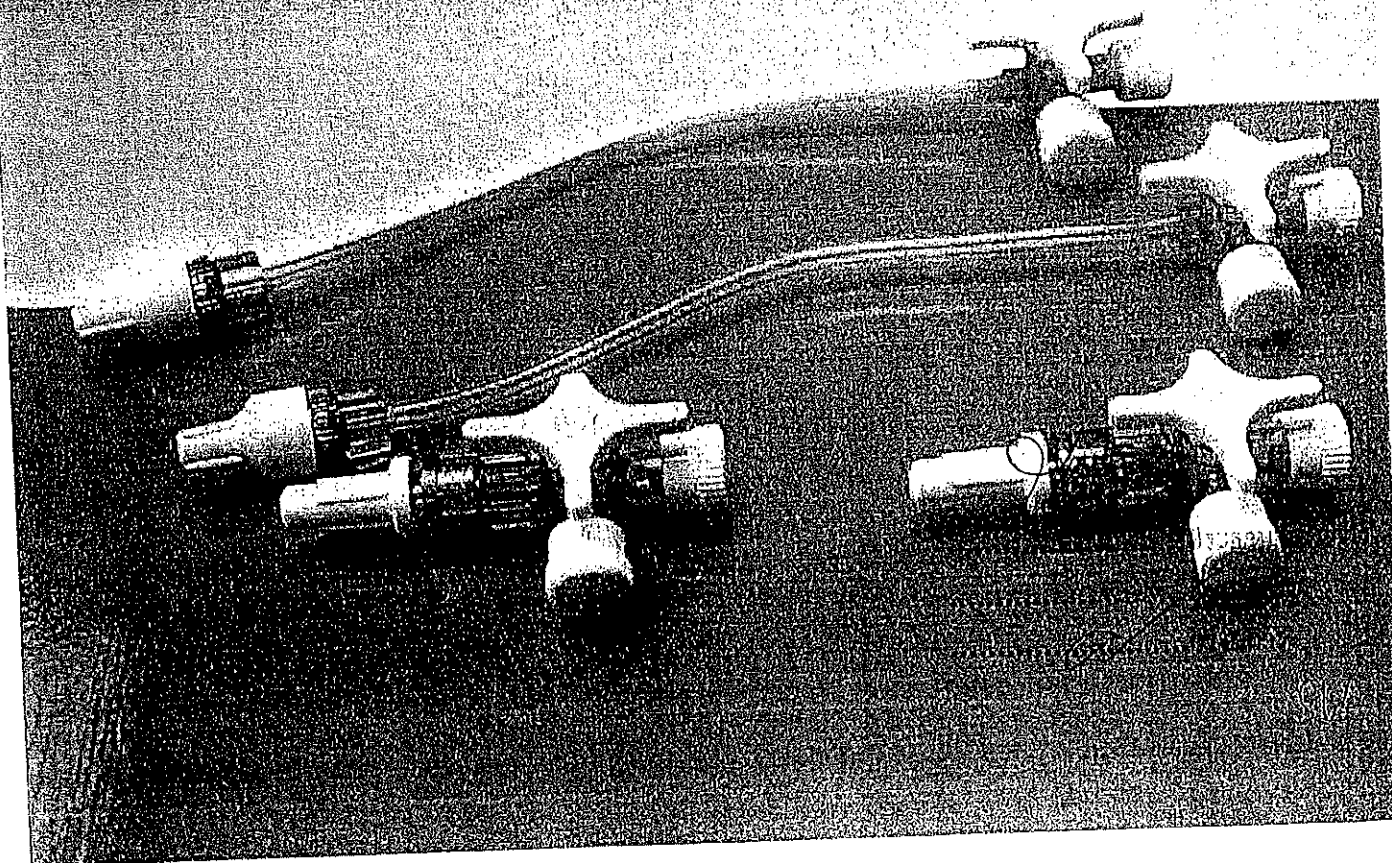



On - Off Snaps Feeling

เมื่อหมุนแกนหมุนไปยังช่องที่ต้องการ
จะมีจังหวะคลิก (Click Lock) เพื่อแสดงว่า
อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแน่นอนไม่ทำให้น้ำซึม

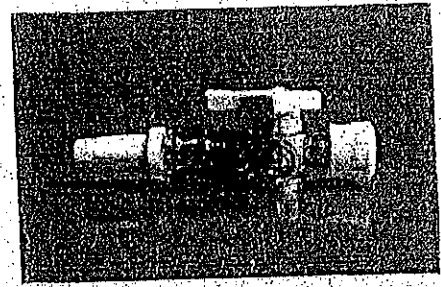



Medical Grade of Polycarbonate.

- ตัวทำจากพลาสติก Medical Grade ชนิด Polycarbonate
แข็งแรง ทนต่อการแตกหัก
- สีควันทนรีไซเคิล สังเกตการไหลของสารน้ำได้ง่าย
- กรณีที่ Reuse ตัวพลาสติกจะไม่เหลือง

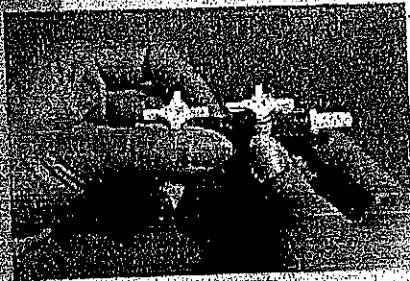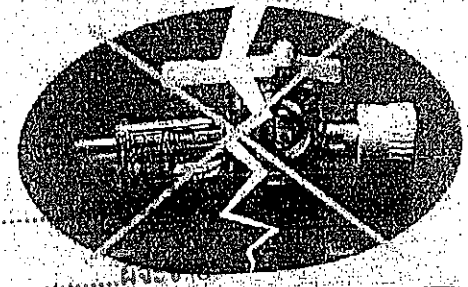



Secure Locking

ปลายท่อด้านที่ใช้ต่อกับ IV. Catheter,
Extension Tube หรือ 3 way stopcock
เป็นข้อต่อชนิด Luer Lock จึงมั่นใจได้ว่า
ข้อต่อต่าง ๆ ไม่รั่วหลุดง่าย

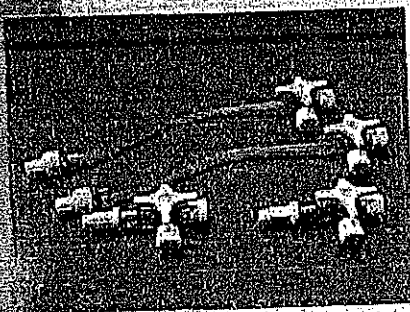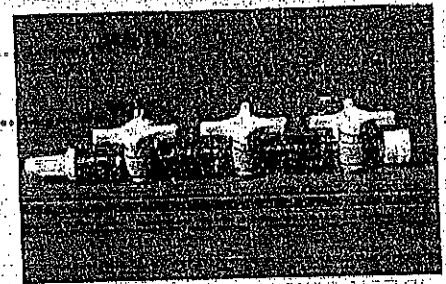


Closed System

มีฝาจุปิดปลายท่อทั้ง 3 ด้าน
ช่วยป้องกัน Contamination

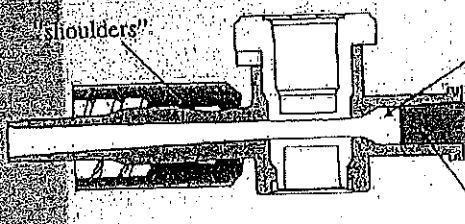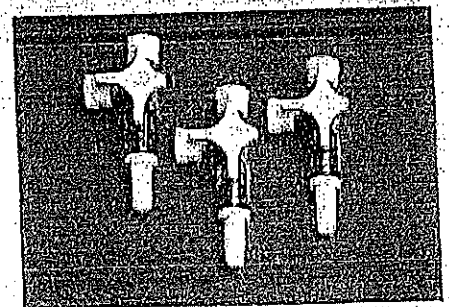

ภายในออกแบบเป็น Slope และมีความยาวของข้อต่อที่เหมาะสม จึงทำให้เกิด
ช่องว่างน้อยที่สุด เมื่อต่อกับสายให้น้ำเกลือ ทำให้อัตราการไหลของสารน้ำ
สม่ำเสมอไม่เกิดฟองอากาศ

ทำจาก Tyvek Package ไม่ใช้กระดาษ
แข็งแรง ไม่ขาดง่าย ถิ่นน้ำได้ดี ระบาย
หมดอายุ อย่างชัดเจน
ช่วยให้ผู้ใช้น้ำใจ ใน Sterility



BD Connecta™ Plus 3		
Catalog	Typ Color	Box
Number Qty		
BD Connecta™ single stopcock		
394600	3-way stopcock	100
394601	3-way stopcock with coding pegs	100
394602	3-way stopcock with coding pegs and red line	100
394603	3-way stopcock with coding pegs and red line	100
BD Connecta™ with Extension Line		
394814	3-way stopcock with 10cm ext.	50
394825	3-way stopcock with 25cm ext.	10
394850	3-way stopcock with 50cm ext.	10
394860	3-way stopcock with 100cm ext.	10

ได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิต
CE-Certificate Number 1141
ISO 9001 และ EN 46001
จากสถาบัน BSI (British Standards
Institution)



BD บริษัท เบทแคป ดิสทริบิว (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 20 อาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทร. 643 1371-80 โทรสาร. 643 1381

SW

Infusion Therapy

Stopcocks for IV Therapy and Pressure Monitoring

BD Connecta™ 3-Way Stopcocks


BD Connecta™ is the result of BD's continuous search for improvement and commitment to risk management in IV therapy.

BD Connecta™ 3-Way Stopcocks offer the possibility to feel whether the stopcock is completely open or closed through the on/off snaps.

The new grade of polycarbonate and high standard moulding technique contribute to improved resistance to cracking.

- Flat clean surface
- Low priming volume (dead space)
- Straight two-way fluid path
- Material allows for use of lipids and chemotherapeutic agents

- Sterilization method: radiation
- Sterile, single use
- CE marked

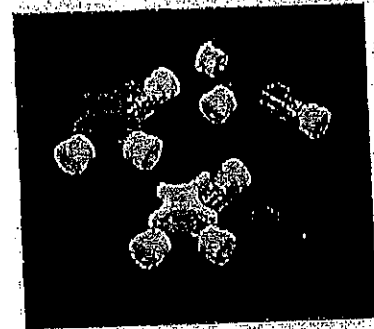

Description	Extension Tubing Length (cm)	Priming Volume (ml)	Shel/Box/Shipping Case	Reference Number
BD Connecta™ 3-Way Stopcocks				
White (without color coding pegs)	-	0,22	100 / 500	394600
White (with color coding pegs red and blue)	-	0,22	100 / 500	394601
Blue	-	0,22	100 / 500	394602
Red	-	0,22	100 / 500	394603
BD Connecta™ 3-Way Stopcocks With Extension Tube				
White	10	0,80	50 / 250	394995
Blue	10	0,80	50 / 250	394997
White	25	1,50	20 / 100	394998
White	50	2,80	20 / 100	394951
White	100	5,50	20 / 100	394950
BD Connecta™ 3-Way Stopcocks with Extension Tube and Valve				
White	7	0,80	50 / 250	394945
White	25	1,50	20 / 100	394936
White	100	5,50	20 / 100	394971
BD Connecta™ 3-Way Stopcock with Low Volume Extension Tube				
White	15	0,30	50 / 250	394982
White	30	0,45	50 / 250	394983


ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



TF002HEL

Technical File TF002HEL

Doc Type
rtf

BD STOPCOCKS

Page 5 of 30

BD CONNECTA™

2014-09-24

nut is assembled.
The nut should lock the stopcock against the product it is connected with.
A white protection cap protects the male luer cone.
The rotating tap has closed and open position indicators when turned (snap ON-OFF).
The rotating tap shows which ports are open. The rotation is 360°.
Certain ref. numbers have a red and a blue color-coding peg enclosed.
They are intended to be fixed to the tap to indicate which blood vessel IV line/pressure line the product is connected to.
Separately, there are color-coding pegs in different colors for other indications.

5. PACKAGING

The product is packed in PE-coated PA-blister, sealed with a paper lid.

Shelf Box

100 or 50 unit packs

Shipping Box

5 or 10 shelf boxes

All packaging sizes are labeled with company, product, lot number, sterilization and expiry date details.

An instruction sheet is enclosed in every shelf box.

6. STERILIZATION

The product is irradiation sterilized by E-beam.

The product is sterile and non-pyrogenic.


7. SALE

The product is to be sold as a sterile product to external customers.

List of Reference Numbers BD Connecta™ stopcock without extension tube

MAT. NO	FORMAT	ASSEMBLY PRODUCT dwg
394600	White	24067
394601	White with color pegs	24067
394602	blue	24068
394605	red	24069
394900	White blend	24067
394901	Blue blend	24068
394902	red blend	24069
394905	yellow blend	24070
394906	White not ISO blend	24046

All Catalog# Sterilization document	QPST-71
All Catalog# Product requirement	PPS-173

4.3 Product Description BD Connecta™ Stopcock with extension tube
From the current version of PS405**BD Connecta™ LL STOPCOCK + extension tube****2. CLINICAL USE**

The product is designed to supply the blood system with fluids or medication coming from one or two different sources via an IV cannula or extension tube.

The product can also be used in diff. combinations in several applications of nutrition administration.

3. USE

Check that protection plugs are tight.

Connect the extension line's male port to female luer connector, by turning and pressing lightly towards each other.

SV

LÄKEMEDELSVERKET
SWEDESH MEDICAL PRODUCTS AGENCY

2020-10-09

Doc: 5.5.2-2020-084603

2 (2)

Article no	Product
394501	BD Connecta™
394502	BD Connecta™
394600	BD Connecta™
394501	BD Connecta™
394502	BD Connecta™
394605	BD Connecta™
394900	BD Connecta™
394901	BD Connecta™
394902	BD Connecta™
394905	BD Connecta™
394906	BD Connecta™
394908	BD Connecta™
394910	BD Connecta™
394911	BD Connecta™
394912	BD Connecta™
395000	BD Connecta™ 25 cm
394926	BD Connecta™ 25 cm
394936	BD Connecta™ 7 cm
394945	BD Connecta™ 50 cm
394951	BD Connecta™ 100 cm
394961	BD Connecta™ 100 cm
394971	BD Connecta™ 100 cm
394995	BD Connecta™ 10 cm
394997	BD Connecta™ 10 cm
395061	BD Connecta™ 10 cm
395095	BD Connecta™ 15 cm
394982	BD Connecta™ 30 cm
394983	BD Plug™
394080	BD Plug™

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ
 ลงชื่อ.....ผู้จะขาย
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

SW

สำนักงาน: ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 101 10110 โทร: 02-254 1000 โทรสาร: 02-254 1001
 โทรสาร: 02-254 1001 โทรสาร: 02-254 1001 โทรสาร: 02-254 1001
 โทรสาร: 02-254 1001 โทรสาร: 02-254 1001 โทรสาร: 02-254 1001



หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย

Becton Dickinson Holdings Pte Ltd เลขที่ 2 International Business Park Road, The Strategy #08-08, Singapore 609930 ("BD") จดทะเบียนฉบับนี้ออกไว้เพื่อขอยืนยันว่า บริษัท จีทีที ฟาร์มา จำกัด ชั้น 8-9 อาคารเพลิกซ์เจเนอเรเตอร์ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย สำหรับสินค้าตามภาคผนวก

หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 หรือจนกว่าจะยกเลิกเอกสารฉบับนี้

Becton Dickinson Holdings Pte Ltd

DocuSigned by:

Raymond Chow

C4770F-11A03F-40F...

By: Raymond Chow

Its: Vice President, General Manager SEA

Date: 22 August 2022

ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

[Signature] ประธานกรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ
SW

Advancing the world of health



Annex
List of Products (the "Products")

No.	Business	Details
1	MDS	Anesthesia Systems
2	MDS	Infusion Specialty Disposables (ISD) excluding TCI/TIVA sets and other sets for using with pumps
3	MDS	Hazardous Drug Safety
4	MDS	Vascular Care
5	MDS	Peripherally Inserted Venous Catheters
6	MDS	Hypodermic Products
7	MDS	Sharps Disposal Systems
8	MDS	Dressings
9	PAS	ABG
10	PAS	Capillary
11	PAS	Safety Lancets
12	PAS	Vacutainer
13	PAS	Safety Wingsets
14	PAS	Safety Needle
15	PAS	Holders
16	PAS	Tourniquets
17	BDB	Pharmingen
18	BDB	Immuno Cytometry System
19	BDB	Flow Cytometer Instrument
20	DS	Blood Culture
21	DS	Core Micro
22	DS	BACTEC Instrument
23	DS	ID/AST
24	DS	TB
25	DS	Veritor
26	DS	MGIT Instrument
27	DS	Molecular
28	DS	Liquid based Cytology
29	DS	Bruker

การจัดทำแผนการทำงาน

รายการที่ 4 T-WAY (3 WHITE)

จำนวน 61,000 อัน ราคาต่ออัน 8.49 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 517,890.- บาท

โดยได้จัดสรรแผนการดำเนินงานในการจัดตั้ง T-WAY (3 WHITE) ให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดสัญญา

งวดที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
เดือน	พย 66	ธค 66	มค 67	กพ 67	มีค 67	เมย 67	พค 67	มีย 67	กค 67	สค 67	กย 67	ตค 67
จำนวน (กล่อง)	11,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสวต เริงชวน)

ผู้รับมอบอำนาจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. ๐ ๔๓๗๑ ๑๗๕๐ - ๔ ต่อ ๕๒๕๖

ที่ มค.๐๐๓๓.๒๐๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การชี้แจงและยืนยันการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ตามที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๔๗,๒๘๐.-บาท (สามล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จัดซื้อด้วยเงิน บำรุงโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวงเงิน ๓,๐๖๘,๐๐๐.-บาท (สามล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม และเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนด วันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในประกาศจังหวัดมหาสารคาม โดยยื่นเสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องเพียงรายเดียว คือ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เสนอราคาวัสดุการแพทย์ รายการที่ ๔ T-WAY (๓WHITE) จำนวน ๖๑,๐๐๐ อันๆละ ๘.๔๙ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๗,๘๙๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้เรียกผู้เสนอราคาชี้แจงและ ยืนยันราคา เพื่อประโยชน์ทางราชการ ปรากฏว่าบริษัทที่ยืนยันราคาเดิมและยืนยันตีแถม T-WAY (๓ผู้จะซื้อ) จำนวน ๕๐๐ อันๆละ ๘.๔๙ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๔๕.-บาท (สี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

พร้อมนี้

พร้อมนี้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและผู้เสนอราคาวัสดุการแพทย์
รายการที่ ๕ T-WAY (๓WHITE) จำนวน ๖๑,๐๐๐ อันๆละ ๘.๔๙ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๗,๘๙๐.-บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และยีนดีแถม T-WAY (๓WHITE) จำนวน ๕๐๐ อันๆละ ๘.๔๙ บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๔๕.-บาท (สี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
(นายชวลิต สงครามยศ)

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
(นายกฤษณ์ โสภณวิวัฒน์)

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....ผู้จะซื้อ
(นางสาววสุน จันทคาม).....กรรมการ

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง ผู้แทนขาย
(จกบ๖๓๓๖ ๖๖๖๖๖๖๖๖)

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร.....ลงวันที่ ๑๖ กย ๕๕
หัวหน้ากลุ่มงาน.....ลงวันที่ ๑๖ กย ๕๕
หัวหน้างาน.....ลงวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๕
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....ลงวันที่ ๑๖/๙/๕๕