

สัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

สัญญาเลขที่

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต เมืองมหาสารคาม

จังหวัด มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่าง จังหวัดมหาสารคาม โดย นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๓๑๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โซโน เมดิคอล จำกัด

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๓๙/๑ หมู่ที่ ๘ ถนน -

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต สามพัน จังหวัด นครปฐม

โดย นายกฤษฎา แสงผล ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสุณี ห่วงฉิมกุล

(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ

รับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗.....แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้จะขายเป็นบุคคลธรรมดา

ให้ใช้ข้อความว่า.....อยู่เลขที่.....-

ถนน ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต

จังหวัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จะขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงจะซื้อจะขาย

ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขายวัสดุการแพทย์ รายการสายดูดเสมหะระบบปิด
สตอโรล (ผู้ใหญ่) จำนวน ๖,๙๐๐ ชิ้นๆ ละ ๒๑๘.- บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๔,๒๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พัน-
สองร้อยบาทถ้วน) ยี่ห้อ Respa Care/ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงด้วยแล้ว จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวนที่ผู้จะซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราวๆ ไป มีกำหนดเวลา ๓๖๕ วัน นับตั้งแต่วันที่.....๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
จนถึงวันที่.....๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.....ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้จะขายรับจะจัดหาสิ่งของที่ผู้จะขายตามวรรคหนึ่ง
เตรียมไว้ให้แก่ผู้จะซื้อได้อย่างเพียงพอตามจำนวนที่คู่สัญญาได้ตกลงประมาณการไว้ในภาคผนวก ๑
แนบท้ายสัญญานี้ แต่ผู้จะซื้ออาจสั่งซื้อจริงมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนประมาณการดังกล่าวก็ได้



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

(นายกฤษฎา แสงผล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการพัสดุ

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้จะขายรับรองว่าสิ่งของที่จะขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ในกรณีที่เป็นการซื้อขายซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้จะขายรับรองว่าเมื่อตรวจสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผผนวก ๑ ใบเสนอราคา	จำนวน	๒	หน้า
๓.๒ ผผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	๓	หน้า
๓.๕ ผผนวก ๕ แคตตาล็อก	จำนวน	๗	หน้า
๓.๓ ผผนวก ๓ แผนการทำงาน	จำนวน	๑	หน้า
๓.๔ ผผนวก ๔ ใบชี้แจงและยืนยันการเสนอราคา	จำนวน	๒	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้จะขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จะซื้อวินิจฉัยของผู้จะซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้จะขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้จะซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การออกไปสั่งซื้อแต่ละคราว

ผู้จะซื้อจะออกไปสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการพร้อมกันก็ได้ ในปริมาณแต่ละรายการคราวละอย่างมาไม่เกิน(.....) หรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า..... (.....) โดยระบุปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่ผู้จะขายจะต้องส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราว ทั้งนี้ผู้จะซื้อ จะออกไปสั่งซื้อมอบให้แก่ผู้จะขายล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อไม่น้อยกว่า.....๓๐..... (.....สามสิบ.....) วัน

ข้อ ๕. การส่งมอบ

ผู้จะขายสัญญาว่าจะส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อตามปริมาณสถานที่และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเองพร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกให้เรียบร้อย



ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

(นายภานุภา แสงผล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักวิชาการพัสดุ

ข้อ ๖. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งซื้อในแต่ละคราวแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งซื้อผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่หรือเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งซื้อด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุผลขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดค่ารับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ซื้อจะชำระเงินค่าสิ่งของที่คำนวณตามปริมาณที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วย ดังระบุไว้ในผนวก ๑ แนบท้ายสัญญานี้ ให้แก่ผู้ขายภายใน.....๓๐.....(.....สามสิบ.....) วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้แสดงหลักฐานการรับมอบตามข้อ ๖ ให้แก่ผู้ซื้อ

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อ.....ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)..... สาขา.....อ้อมใหญ่.....
ชื่อบัญชี.....บริษัท ไฮโน เมดิคอล จำกัด.....ประเภทบัญชี.....ออมทรัพย์.....
เลขที่บัญชี.....๓๒๑-๔๔๘๘๑๐๘-๘.....ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้กำหนดแล้วแต่กรณี)

ข้อ ๘. การรับประกันการชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ๑.....(.....หนึ่ง.....) ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้ เกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕.....(.....สิบห้า.....) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นหากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขายโดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายฤทธิญา แสงผล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักวิชาการพัสดุ

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็วและไม่อาจรอคอยให้ผู้จะขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้จะซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเองหรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยผู้จะขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้จะซื้อทำการนั้นเองหรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้จะขายไม่ทำให้ผู้จะขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้จะขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้จะซื้อเรียกร้องผู้จะซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้จะขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน.....
โรงพยาบาลมหาสารคาม เล่มที่ มค.๐๑/๖๕๒๒ เลขที่ ๐๑๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เป็นจำนวนเงิน ๗๕,๒๑๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน).....ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....๕..... (.....ห้า.....)
ของราคาประมาณการตามข้อ ๑ มามอบไว้แก่ผู้จะซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้จะขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้จะขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้จะขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้จะขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้จะขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้จะขายตลอดอายุสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้จะขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้จะขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้จะซื้อภายใน.....๗.....(.....เจ็ด.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ

หลักประกันที่ผู้จะขายนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้จะซื้อจะคืนให้เมื่อผู้จะขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว



ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

(นายภุชงค์ แสงผล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักวิชาการพัสดุ

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

ในกรณีที่ผู้จะซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาผู้จะซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามสัญญาข้อ ๙ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้จะซื้อเห็นสมควรและถ้าผู้จะซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณี ภายในกำหนด(หนึ่ง) เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้จะขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๑. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๑๐ ผู้จะขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้จะซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ .๐.๒๐...(ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อหรือจนถึงวันที่ผู้จะซื้อได้สั่งซื้อสิ่งของตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอื่นในกรณีนี้ผู้จะขายยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวด้วย ซึ่งผู้จะขายตกลงให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าปรับและราคาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจากราคาส่งของตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้หรือให้ผู้จะซื้อเรียกร้องจากผู้จะขายตามสัญญาข้อ ๑๒ หรือจะเรียกร้องจากหลักประกันสัญญาตามข้อ ๙ ก็ได้ ตามที่ผู้จะซื้อจะเห็นสมควร

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงจะซื้อขายประกอบกันเป็นชุดแต่ผู้จะขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้จะซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้จะซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๐ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้จะซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้จะขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อแล้วผู้จะซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้จะขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

(นายกฤษฎา แสงผล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักวิชาการพัสดุ

ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้จะซื้อ ผู้จะขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้จะซื้อ โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....๓๐.....(สามสิบ.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ หากผู้จะขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้จะซื้อ มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขาย ที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอผู้จะขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....๓๐.....(สามสิบ.....) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผู้จะขายทั้งหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความรับผิดชอบหรือความบกพร่องของ ฝ่ายผู้จะซื้อ หรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้จะขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้จะขาย ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้จะขายมีสิทธิขอขยายเวลาทำการ ตามสัญญาหรือขอลดหรืองดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ ผู้จะซื้อทราบภายใน ๑๕.....(สิบห้า.....) วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้จะขายได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญาเพื่อลดหรือลดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิด จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้จะซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายเวลาทำการตามสัญญาเพื่อลดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้จะซื้อ ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

(นายกฤษณ์ แสงผล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญญา คำพอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักวิชาการพัสดุ

ข้อ ๑๔. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อตามสัญญานี้เป็นสิ่งของผู้จะขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศและสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้จะขายจะต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นำก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อของดังกล่าวจากต่างประเทศเป็นแบบเอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีเอฟเอฟ หรือเป็นแบบอื่นใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้จะขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยแก่ผู้จะซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้จะขายจะต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นำให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้จะซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้จะซื้อแต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้จะซื้อก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้จะซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้จะขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

(นายกฤษฎา แสงผล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักวิชาการพัสดุ

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ซิโน เมดิคอล จำกัด เลขที่ ๑๓๙/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๗๐๐๔๕๓๘ โดย นางสาวอนัญญา หวังวนิชกุล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๘๘/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบ
๑	สายดูดเสมหะระบบปิดสเตอไรล์ (ผู้ใหญ่)	-	๖,๙๐๐ ชิ้น/piece	๑,๕๐๔,๒๐๐.๐๐	๓๖๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑,๕๐๔,๒๐๐.๐๐	

(หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด อาจรับคำเสนอ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

รับรองที่จะ

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายลงที่หน่วยงานเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ภายใน จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้

ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือจังหวัด อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ จังหวัด

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙:๐๖:๑๔ น.

(นางสาวอนัญญา หวังวนิชกุล)

กรรมการผู้จัดการ

SINO
SINO MEDICAL CO., LTD.

เลขที่โครงการ ๖๗๐๑๙๑๖๔๒๓๑

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๖๑๖๐๐๓๒๔๖๗

รหัสอ้างอิง OTP nrXE

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๖๑๐๑๖๗๕๕

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

คุณลักษณะเฉพาะ

สายดูดเสมหะระบบปิด Closed Suction

1. คุณลักษณะทั่วไป

ใช้ดูดเสมหะให้ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal Tube หรือ Tracheostomy Tube) ด้วยระบบปิด (Close System) เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากภายนอกสู่ตัวผู้ป่วย และจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ถูกรบกวนจากการดูดเสมหะในระหว่างการช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นสายดูดเสมหะระบบปิด สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง และเป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ

2.1. ส่วนข้อต่อด้านทางเข้า ประกอบด้วยข้อต่อ 3 ทาง

2.1.1. ข้อต่อด้านตรงสำหรับต่อท่อช่วยหายใจสามารถสวมได้พอดีกับท่อช่วยหายใจที่มีขนาดมาตรฐานทางการแพทย์

2.1.2. ข้อต่อด้านข้างสำหรับสวมเข้ากับ Breathing Circuit ของเครื่องช่วยหายใจ สามารถปรับทิศทางหมุนได้ 360 องศา เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำผู้ป่วย

2.1.3. บริเวณข้อต่อมีช่องสำหรับยาพ่น Metered Dose Inhaler (MDI) หรือสามารถเปลี่ยนข้อต่อเป็นช่องสำหรับหยอดสารละลาย Normal Sterile Solution (NSS) เพื่อช่วยละลายเสมหะ


2.1.4. มี Port 2 Port แยกการใช้งานให้เห็นชัดเจน คือ

2.1.4.1. มีช่องหยอด Normal Sterile Solution (NSS) ให้ผู้ป่วยกรณีที่มีเสมหะเหนียวมาก เพื่อช่วยละลายเสมหะ ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

2.1.4.2. มีช่องล้างสาย Suction ในกรณีที่มีเสมหะค้างอยู่ในสาย โดยแยกหลอดช่วยหายใจ Normal Sterile Solution (NSS) ลงชื่อ.....พยาน

2.2. ส่วนสายดูดเสมหะ ประกอบด้วย

2.2.1. สายดูดเสมหะระบบปิดทำด้วยวัสดุ PVC High Density Polyvinyl chloride ชนิด Medical grade ลักษณะใส และอ่อนนุ่ม ไม่ระคายเคืองต่อผนังหลอดลม บริเวณปลายสายมีลักษณะปลายเปิดผิวเรียบโค้งมนและนุ่ม มี 3 รู โดยเป็นรูเปิดส่วนปลาย 1 รู ด้านข้าง 2 รู ตำแหน่งเหลื่อมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดเสมหะ และเป็นช่องเปิดสำรองในกรณีมีเสมหะอุดตันบริเวณปลายสาย ปลายสายมีสัญลักษณ์เส้นทึบเพื่อให้สังเกตตำแหน่งของปลายสายได้อย่างชัดเจน



SINO
SINO MEDICAL CO., LTD.

- 2.2.2. สายดูดเสมหะ มีขีดบอกระยะเป็นเส้นทึบเป็นระยะๆ ทุกๆ 1 เซนติเมตร เพื่อให้ทราบถึงความลึกของสายดูดเสมหะ ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน
- 2.2.3. มีเส้นทึบบ่งบอกระยะในการเก็บสายเมื่อใช้งานในแต่ละครั้งเสร็จอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง
- 2.2.4. วัสดุพลาสติกหุ้มสายดูดเสมหะ ผลิตจากวัสดุ PVC ชนิด Medical grade ที่มีความเหนียว ยืดหยุ่น นิ่ม ทนทานและโปร่งใส สามารถมองเห็นภายในได้ดี สามารถปรับหดตามระยะสายดูดเสมหะที่สอดผ่านท่อช่วยหายใจได้ โดยปลายถุงส่วนหนึ่งจะผนึกติดกับส่วนข้อต่อด้านบนและปลายอีกด้านหนึ่งผนึกติดกับส่วนควบคุมการดูดเสมหะด้วยมือ
- 2.2.5. Suction Control Valve มีสัญลักษณ์หมุนเปิด-ปิด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมระบุสีตามขนาดมาตรฐานสากลและสังเกตเห็นได้ชัดเจน
- 2.3. ส่วนควบคุมการดูดเสมหะ ประกอบด้วย
- 2.3.1. Control Valve ปุ่มควบคุมการดูดเสมหะสามารถใช้มือกดเพื่อแสดงว่าดูด และปล่อยจะแสดงว่าหยุดดูด มีสีประจำในแต่ละเบอร์ ออกแบบมาพิเศษให้เห็นการทำงานของปุ่ม เพื่อดูประสิทธิภาพในการทำงานของปุ่มควบคุมการดูดเสมหะ
- 2.3.2. มีระบบล็อก Thumb port เมื่อไม่ต้องการใช้งานซึ่งจะล็อกไม่ให้ระบบดูดเสมหะทำงานได้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการกด Thumb port โดยไม่ตั้งใจ
- 2.3.3. ข้อต่อ Pipe Line เป็นข้อต่อตัวหนอนพร้อมฝาปิดที่ยึดติดเป็นชิ้นเดียวกับตัวปุ่มกด Suction เพื่อป้องกันการหลุดหรือหล่นหาย สำหรับต่อเข้ากับท่อดูดเสมหะด้วยลม
- 2.3.4. มีขนาดให้เลือกใช้งานที่เหมาะสมกับผู้ป่วยทารกแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ ตั้งแต่ 6, 8, 10, 12, 14 และ 16 Fr
- 2.4. มี Valve แบบกึ่งอัตโนมัติ แบบหมุนเพื่อหมุนเปิดปิด สำหรับป้องกันน้ำไหลที่ใช้ในการล้างสาย ไหลย้อนกลับสู่ทางเดินหายใจของคนไข้ได้
- 2.5. มี Wedge (ที่รัด) เพื่อช่วยในการถอดท่อช่วยหายใจจาก Closed Suction Catheter มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์เป็นสีต่างๆ ไม่ซ้ำกัน โดยแยกตามจำนวนวันในสัปดาห์ พร้อมพิมพ์ข้อความระบุเป็นชื่อวันจันทร์-อาทิตย์ แบนมาพร้อมกับซองบรรจุ ^{ซองที่ใช้ติดเป็นข้อสังเกตและสะดวกในการติดตามผล} ลงชื่อ.....ผู้จะขาย
- 2.6. มีข้อต่อสำหรับยาพ่น Metered Dose Inhaler (MDI) และมีข้อต่อสำหรับหยอดสารละลาย Normal Sterile Solution (NSS) ให้เลือกใช้งาน ลงชื่อ.....พยาน
- 2.7. สายดูดเสมหะระบบปิดแต่ละเส้น ถูกบรรจุลงในซองแบบ Peel Pouch ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย EO gas ตามมาตรฐานสากล ISO 13485 เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีและบริเวณของบรรจุภัณฑ์มีการระบุขนาด รหัสรอบการผลิต (Lot No.) วันที่ผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจนง่ายต่อการสังเกตและตรวจสอบ
- 2.8. สามารถใช้ได้กับ Suction Tube Fr 10,12,14,16



3. บรรจุหีบห่อ



1. บรรจุภัณฑ์เป็นแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานปราศจากเชื้อ (Sterile Packing)
2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการทำให้ปราศจากเชื้อ โดยใช้ก๊าซเอทิลีนออกไซด์ (E.O. Gas Sterilization) ตามมาตรฐานสากล
3. ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น ต่อ 1 ซอง

4. เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใช้ครั้งเดียว เป็นของใหม่ เป็นของแท้ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ
2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพการผลิต การจัดเก็บและขนส่ง การจัดจำหน่าย การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 13485 และมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล CE Mark
3. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001
4. ผลิตภัณฑ์มีใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์และใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกโดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
5. บริษัท มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต
6. บริษัท ยินยอมรับเปลี่ยนเวชภัณฑ์คืนทุกกรณี หากผลิตภัณฑ์ชำรุด เสียหาย หรือกรณีหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพก่อนกำหนด โดยไม่มีเงื่อนไข
7. บริษัท ยินดีส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบการใช้งาน ตามแต่ที่คณะกรรมการกำหนด
8. ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผล โรงพยาบาลมหาสารคามจะไม่รับพัสดุ หากผลิตภัณฑ์ชำรุด หรือเสื่อมสภาพลงก่อนหมดอายุการใช้งาน ผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนได้โดยไม่คิดมูลค่า
9. ผู้เสนอราคาได้แสดงแคตตาล็อก และเอกสารที่บริษัทผู้ผลิตระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจนทุกรายการเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาสามารถชี้แจงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการได้ หากการเสนอเอกสารที่ไม่ตรงตามความต้องการ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและพิจารณาสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของทางราชการ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

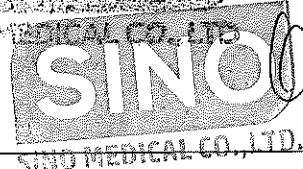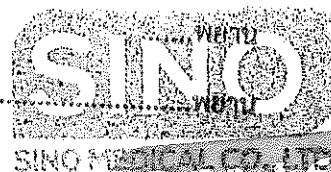

RespaCare


Closed suction system allows the patient to receive continuous ventilation support during tracheobronchial secretion removal procedures while effectively controlling infections by reducing cross contamination.

Suction Catheter Features:

- Distal end of catheter has 3 holes: 1 hole at the distal tip and 2 holes on the sides at different locations to prevent catheter occlusion Spec ข้อ 3.2
- Spec ข้อ 3.2.1.1 และ 3.2.2.1
- Suction catheter is made from medical grade high density polyvinyl chloride (PVC) with extra soft tip
- Suction catheter is available in various lengths and is compatible with all types of tracheal tubes including tracheostomy tubes
- Scale marking on catheter for ease in visualization of depth during procedure. Scale marking are printed on catheter from 6 cm - 25 cm with markings every centimeter in between
- Distal end marking enables easy identification of catheter position for storing after use Spec ข้อ 3.2.2.2
- Plastic sleeves wrapping the catheter is made from medical grade PVC that is durable, elastic and resistant to tearing. Spec ข้อ 3.2.2.3

Sliding Isolation Valve:

- Spec ข้อ 3.3
- Isolates catheter for safety while rinsing and prevents saline solution from entering patient's endotracheal tube.
- Valve also supports effective ventilator setting by preventing oxygen from leaking out of the ventilation system. Spec ข้อ 3.3

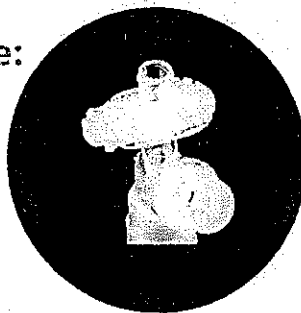

RespaCare Closed Suction Systems are supplied with: Spec ข้อ 3.2.2.4



- Day stickers to identify change requirements
- Disconnection Wedge for removal of closed suction system from endotracheal and tracheostomy tubes

Closed Suction System - 72 Hour Type

Spec ข้อ 3.1


Multi-port Adapter:

Endotracheal tube port with 15 mm connector.

Breathing circuit connector that can rotate 360 degree for ease in positioning. Spec ข้อ 3.2.1

One way valve side port used for rinsing and dissolving thick secretion with normal saline solution (NSS).

Metered dose inhaler port (MDI) for medication delivery.

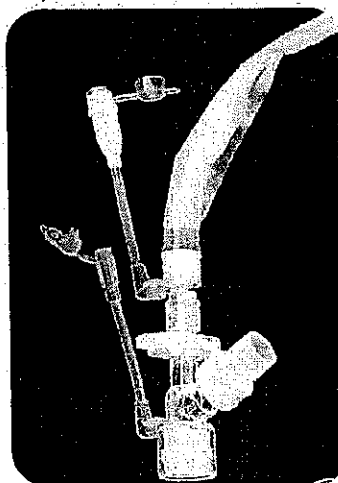


Control Valve:

Spec ข้อ 3.2.3.1
Press and release control valve to activate and deactivate suction.

Spec ข้อ 3.2.2.4
Control Valve is color coded according to international standards for easy identification

Control valve can be locked to prevent patient accidentally. To lock, turn the valve 180 degrees and turn the valve again to unlock.

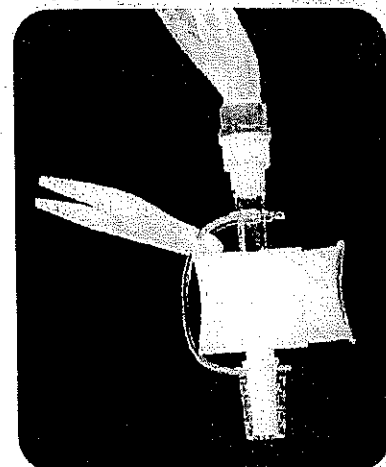

Suction connecting tube with attached cap securely connects closed suction system with pipeline Spec ข้อ 3.2.3.2

Product Specifications:

6Fr 12Fr Packaging: Blister Pack

8Fr 14Fr

10Fr 16Fr

Spec ข้อ 3.7


Unit Qty.: 1 piece/ blister Spec ข้อ 3.4

Box Qty.: 10 pieces/ box

Sterilization: Ethylene Oxide Gas Spec ข้อ 3.5

SINO MEDICAL CO., LTD.


For additional information:
Sino Medical Co. Ltd.
Tel: 093-7892551
contact@sinomedical.co.th

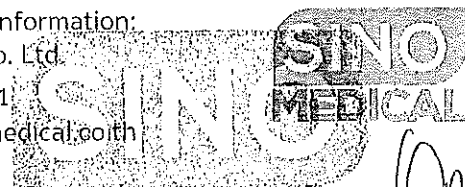

SINO MEDICAL CO. LTD

ภาพถ่ายสินค้า รายการสายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction)

ขนาด 6 Fr

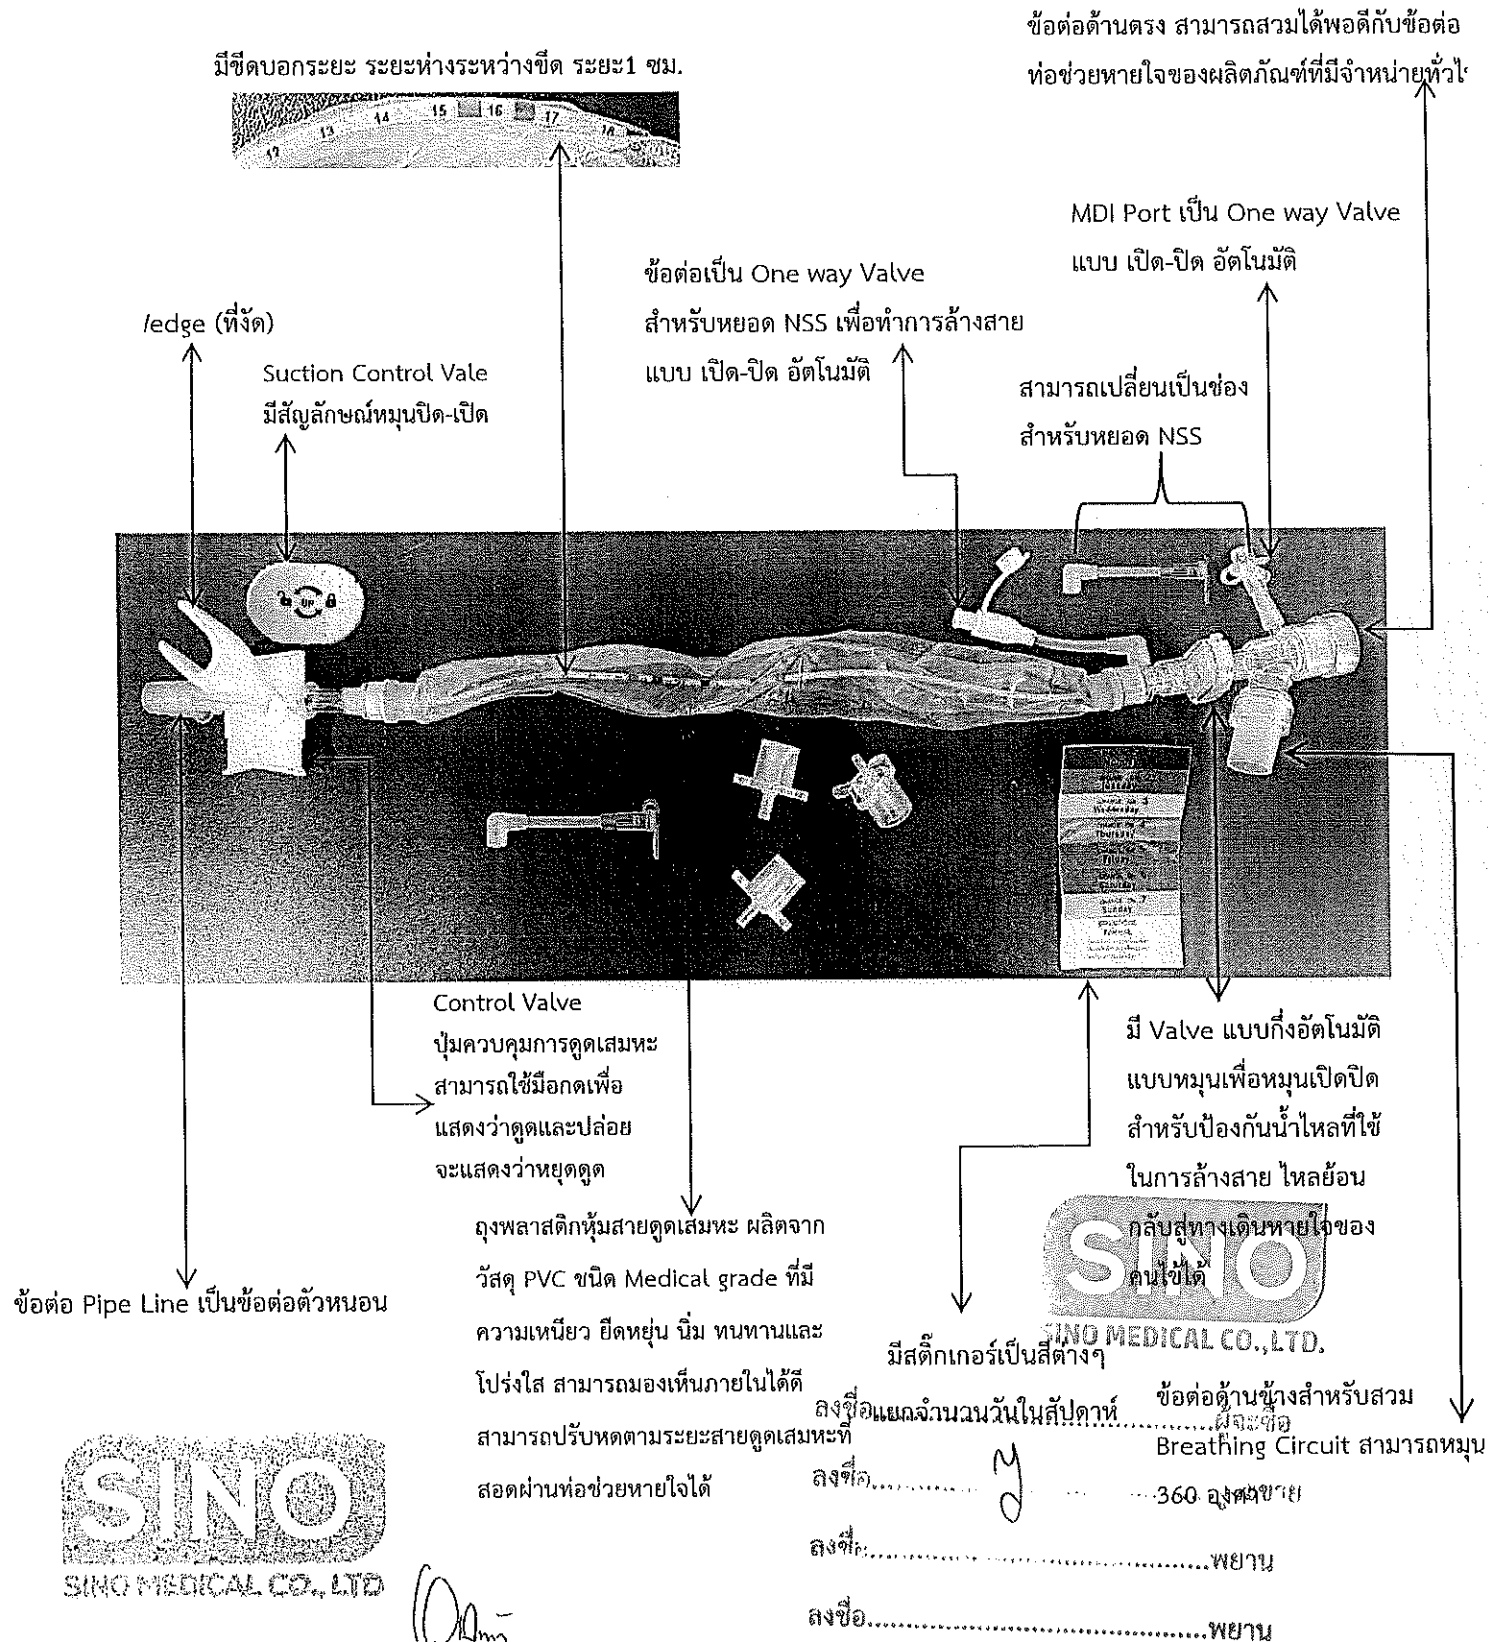

ภาพถ่ายสินค้า รายการสายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction)

ขนาด 8 Fr

มีขีดบอกระยะ ระยะห่างระหว่างขีด ระยะ 1 ซม.




ข้อต่อด้านตรง สามารถสวมได้พอดีกับข้อต่อ
ท่อช่วยหายใจของผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป

ข้อต่อด้านข้างสำหรับสวม
Breathing Circuit สามารถหมุนได้
360 องศา

ข้อต่อเป็น One way Valve
สำหรับหยอด NSS เพื่อทำการล้างสาย
แบบ เปิด-ปิด อัตโนมัติ

มีสติกเกอร์เป็นสีต่างๆ
แยกจำนวนวันในสัปดาห์

Wedge (ที่จับ)

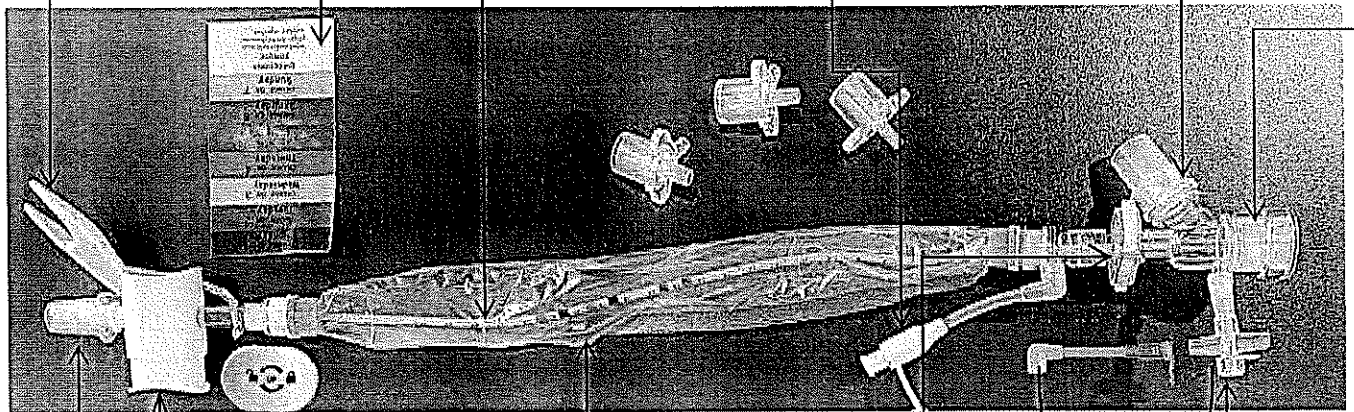

Suction Control Valve
มีสัญลักษณ์หมุนปิด-เปิด

Control Valve ปุ่มควบคุม
การดูดเสมหะสามารถใช้มือกด
เพื่อแสดงว่าดูด และปล่อยจะแสดง
ว่าหยุดดูด

ข้อต่อ Pipe Line เป็นข้อต่อตัวหนอน



Om

ถุงพลาสติกหุ้มสายดูดเสมหะ ผลิตจากวัสดุ PVC
ชนิด Medical grade ที่มีความเหนียวสูง
นิ่ม ทนทานและโปร่งใส สามารถมองเห็นภายในได้
ดี สามารถปรับหดตามระยะสายดูดเสมหะที่สอด
ผ่านท่อช่วยหายใจได้



สามารถเปลี่ยนเป็นช่อง
สำหรับหยอด NSS
MDI Port เป็น One way Valve
ผู้จะขาย
แบบ เปิด-ปิด อัตโนมัติ
เพียวาน


มี Valve แบบกึ่งอัตโนมัติ แบบหมุนเพื่อหมุน...เพียวาน
เปิดปิด สำหรับป้องกันน้ำไหลที่ใช้ ในการล้าง
สาย ไหลย้อน กลับสู่ทางเดินหายใจของ
คนไข้ได้

ภาพถ่ายสินค้า รายการสายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction)

ขนาด 14 Fr

มีขีดบอกระยะ ระยะห่างระหว่างขีด ระยะ 1 ซม.

ข้อต่อด้านตรง สามารถสวมได้พอดีกับข้อต่อ
ท่อช่วยหายใจของผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป

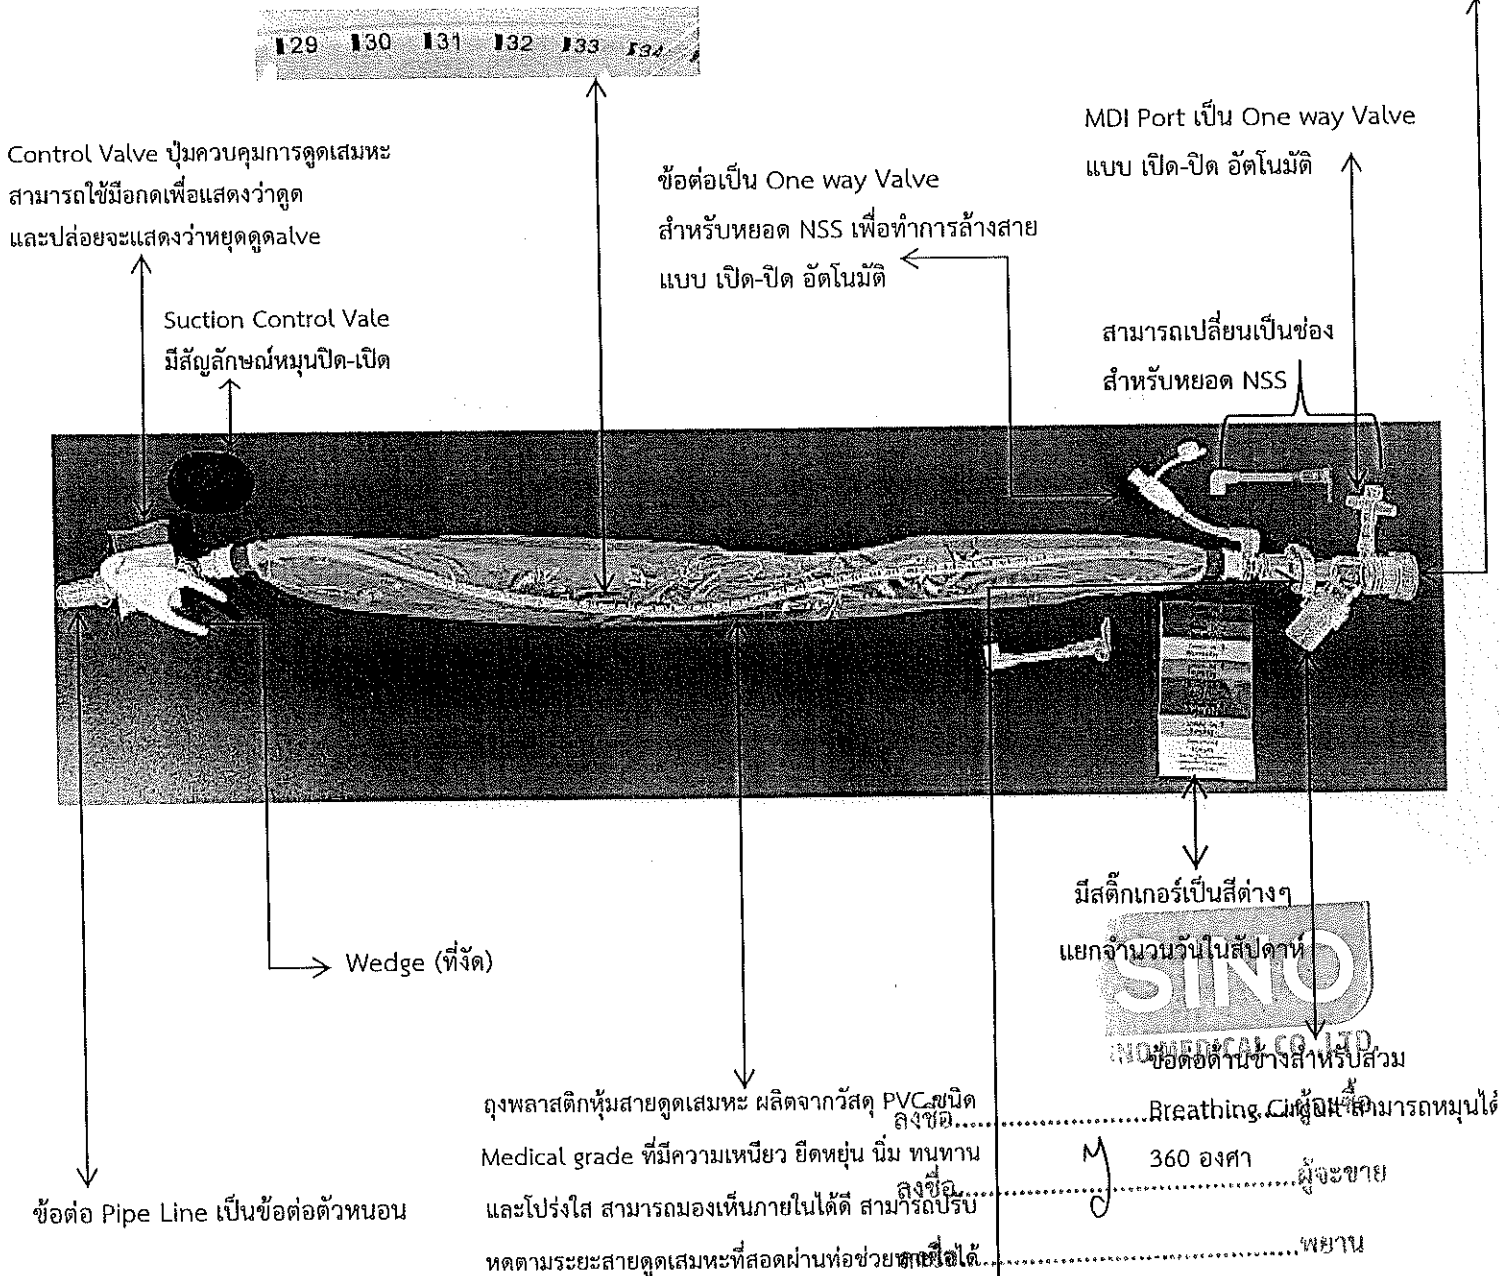

Om

ภาพถ่ายฉลากสินค้า รายการสายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction)

ขนาด 6 Fr

แสดงเครื่องหมาย


- รับรองคุณภาพระดับสากล
- ห้ามนำไปใช้ซ้ำ
- วิธีการปราศจากเชื้อด้วยวิธี

Ethylene Oxide



REF	6FR
LOT	20220715
	2022.07.15
	2027.07.14


ระบุ
-ขนาดสินค้า
-เลขที่ผลิต (Lot)
-วันเดือนปีที่ทำการฆ่าเชื้อ
-วันเดือนปีที่หมดอายุของการ
ฆ่าเชื้อ

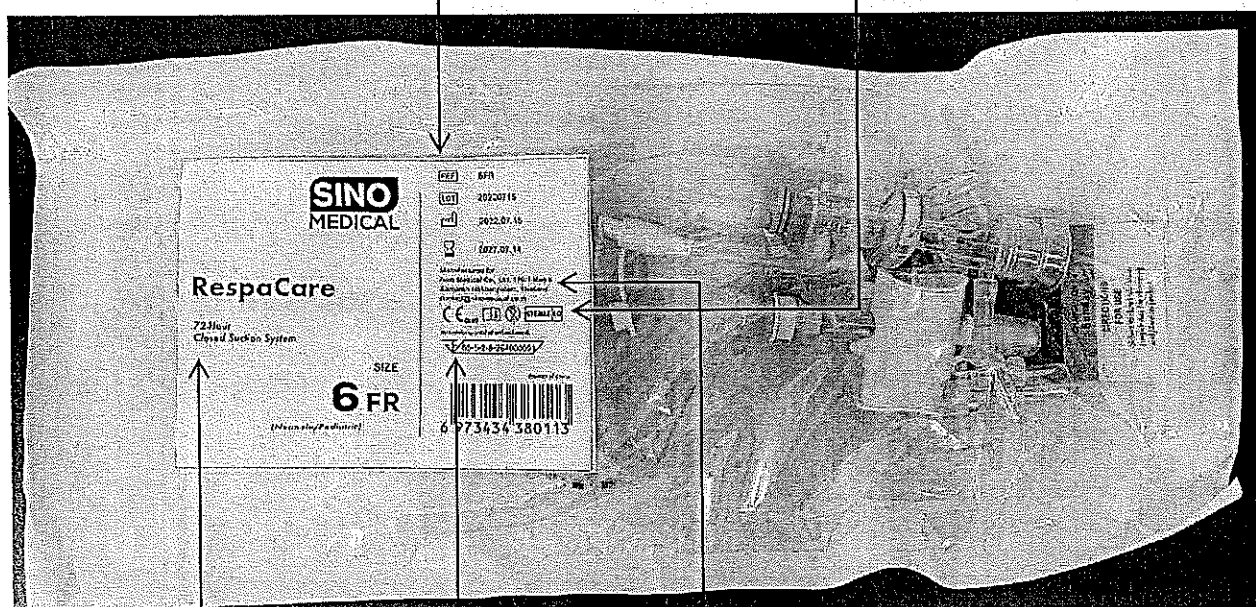

72-Hour
Closed Suction System

สายดูดเสมหะผู้ป่วยแบบระบบปิดใช้
งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

Manufactured for:
Sino Medical Co., Ltd. 139/1 Moo 8
Sampran Nakorn Pathom, Thailand
contact@sino-medical.co.th




แสดงชื่อบริษัทนำเข้าสินค้า

แสดงเครื่องหมาย

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

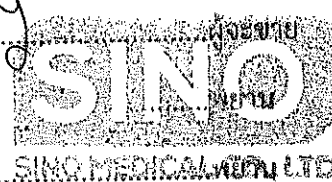

ภาพถ่ายฉลากสินค้า รายการสายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction)

ขนาด 8 Fr

REF	8FR
Lot	20220715
	2022.07.15
	2027.07.14

ระบุ
-ขนาดสินค้า
-เลขที่ผลิต (Lot)
-วันเดือนปีที่ทำการฆ่าเชื้อ


แสดงเครื่องหมาย

- รับรองคุณภาพระดับสากล
- ห้ามนำไปใช้ซ้ำ
- วิธีการปราศจากเชื้อด้วยวิธี

Ethylene Oxide




-วันเดือนปีที่หมดอายุของการ
ฆ่าเชื้อ

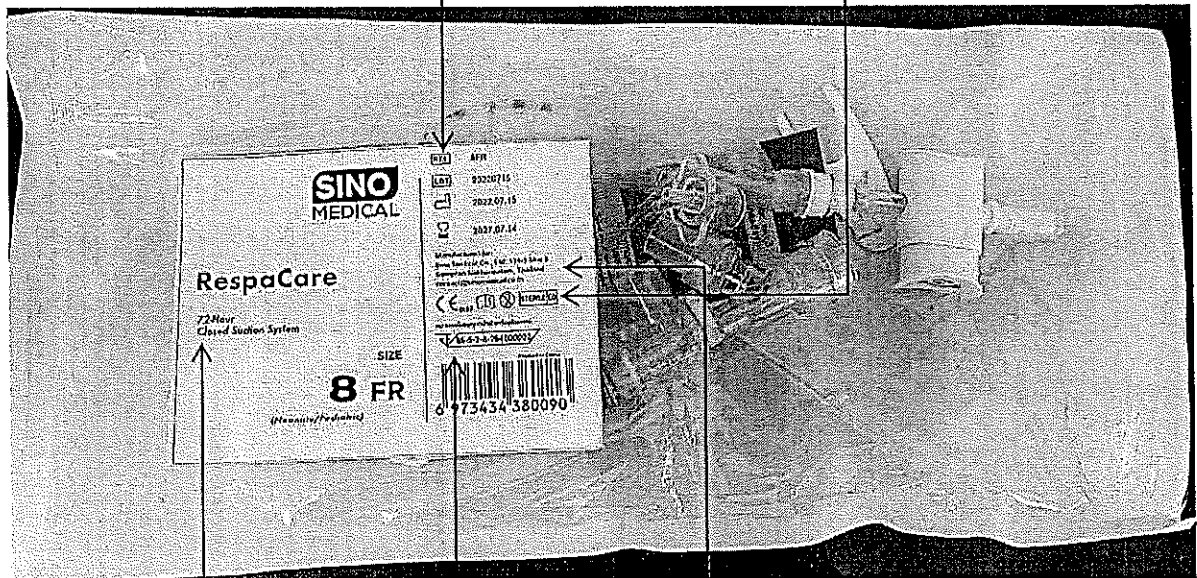

72-Hour
Closed Suction System

สายดูดเสมหะผู้ป่วยแบบระบบปิดใช้
งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

Manufactured for:
Sino Medical Co., Ltd. 139/1 Moo 8
Sampran Nakornpathom, Thailand
contact@sinomedical.co.th



แสดงเครื่องหมาย.

แสดงชื่อบริษัทนำเข้าสินค้า

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

ล. ส. พยาน

SINO MEDICAL CO., LTD

พยาน

ภาพถ่ายฉลากสินค้า รายการสายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction)

ขนาด 14 Fr

REF	14FR
LOT	20230720
EXP	2023.07.20
EXP	2028.07.19

ระบุ

- ขนาดสินค้า
- เลขที่ผลิต (Lot)
- วันเดือนปีที่ทำการฆ่าเชื้อ
- วันเดือนปีที่หมดอายุของการฆ่าเชื้อ


แสดงเครื่องหมาย

- รับรองคุณภาพระดับสากล
- ห้ามนำไปใช้ซ้ำ
- วิธีการปราศจากเชื้อด้วยวิธี

Ethylene Oxide



72-Hour
Closed Suction System



แสดงเครื่องหมาย

Manufactured for:
Sino Medical Co., Ltd. 139/1 Moo 8
Sampran Nakornpathom, Thailand
contact@sino-medical.co.th

แสดงชื่อบริษัทนำเข้าสินค้า

SINO
SINO MEDICAL CO., LTD.

สายดูดเสมหะผู้ป่วยแบบระบบปิดใช้
งานได้ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

SINO MEDICAL CO., LTD.

ลงชื่อ..... พยาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. ๐-๔๓๗๑-๑๗๕๐-๔ ต่อ ๙๒๕๖

ที่ มค.๐๐๓๓.๒๐๑/ ๗๘๐๘ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การชี้แจงและยืนยันการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ตามที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๓๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวงเงิน ๔,๓๕๐,๖๐๐.-บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม และเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในประกาศจังหวัดมหาสารคาม โดยเสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท ไฮโน เมติกอล จำกัด เสนอราคาวัสดุการแพทย์ รายการ สายดูดเสมหะระบบ ปิดสโตรโรล์ (ผู้ใหญ่) จำนวน ๖,๙๐๐ ชิ้นๆละ ๒๑๘ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๔,๒๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	บริษัท ไฮโน เมติกอล จำกัด		งบประมาณ		ราคากลาง	
	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
สายดูดเสมหะระบบ ปิดสโตรโรล์ (ผู้ใหญ่)	๒๑๘	๑,๕๐๔,๒๐๐	๒๗๐	๑,๘๖๓,๐๐๐	๒๗๐	๑,๘๖๓,๐๐๐

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้เรียกผู้เสนอราคามาชี้แจงและยืนยันราคา เพื่อประโยชน์ทางราชการ ปรากฏว่าบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมและยืนยันดีแอม สายดูดเสมหะระบบปิดสโตรโรล์ (ผู้ใหญ่) จำนวน ๘๐ ชิ้นๆละ ๒๑๘ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๔๔๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และส่งพัสดุที่แถม ในใบสั่งซื้อครั้งที่ ๑ หลังจากเซ็นสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ.

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ


ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

ลงชื่อ.....พยาน


ลงชื่อ.....พยาน

พร้อม...

พร้อมนี้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและผู้เสนอราคาวัสดุการแพทย์
รายการ สายดูดเสมหะระบบปิดสเตอไรล์ (ผู้ใหญ่) จำนวน ๖,๙๐๐ ชิ้นๆละ ๒๑๘ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๕๐๔,๒๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) และยีนดีแถม สายดูดเสมหะระบบปิดสเตอไรล์ (ผู้ใหญ่)
จำนวน ๘๐ ชิ้นๆละ ๒๑๘ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๔๔๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล)

ลงชื่อ..........ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
(นายกฤษณ์ โสภณวิวัฒน์)

ลงชื่อ..........ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
(นางสายวุลน จันทคาม)



ลงชื่อ..........ตำแหน่ง ผู้แทนขาย
(รณดโรมันท์ ทรัพย์)

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ลงชื่อ.....พยาน

.....พยาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร.....ลงวันที่.....
หัวหน้ากลุ่มงาน.....ลงวันที่.....
หัวหน้างาน.....ลงวันที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....ลงวันที่.....



บริษัท ไชโน เมดิคอล จำกัด

139/1 หมู่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

081-7004538, 083-7893697 contact@sinomedical.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID 0105561016759 สำนักงานใหญ่

ใบเสนอราคา / Quotation

M-015

เรียน ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาล มหาสารคาม

168 ถ.ศุภวิถี ต.ตลาด

อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000401515 ☒ สำนักงานใหญ่

Tax ID

โทร. 043-711750

Tel.

อ้างอิง

Reference.

เลขที่ใบเสนอราคา

QT2401-021

Quotation No.

วันที่

10/01/67

Date

ยี่สิบราคา

180

วัน

ถึงวันที่

08/07/67

Valid Price

Days

Valid bill

เงื่อนไขชำระเงิน

30 วัน หลังส่งมอบ

Payment Term

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	ราคารวมภาษี Amount
1	14 FR Closed Suction Catheter for single use 14FR	6,900.00 ชิ้น	270.00		1,863,000.00
		ลงชื่อ.....			ผู้จะซื้อ
		ลงชื่อ.....			ผู้จะขาย
		ลงชื่อ.....			พยาน
		ลงชื่อ.....			พยาน
หมายเหตุ Remark		รวมเป็นเงิน Subtotal			1,863,000.00
1.ส่งสินค้าภายใน 15 วัน		หัก ส่วนลด Less Discount			0.00
2.รับประกันคุณภาพ 1 ปี (สินค้ามีวันหมดอายุข้างซอง)		ราคาสินค้า Net Amount			1,741,121.50
3.ผู้แทนขาย นายพีรวิทย์ หวังวิชกุล 093-789-2551		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount			121,878.50
(หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน).		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Amount			1,863,000.00
กรุณารับรองยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้ Please sign below for purchasing confirmation.		ขอแสดงความนับถือ บริษัท ไชโน เมดิคอล จำกัด			
() ผู้สั่งซื้อสินค้า/ Ordered by		/ / วันที่/ Date			
		ผู้เสนอราคา/ Prepared by			




การจัดแผนการทำงาน

รายการ	งวดที่1	งวดที่2	งวดที่3	งวดที่4	งวดที่5	งวดที่6	งวดที่7	งวดที่8	งวดที่9	งวดที่10	งวดที่11	งวดที่12
	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ด.ค
สายดูดเสมหะแบบปิดสเตอไรล์	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575



ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา แสงผล)
ผู้รับมอบอำนาจ

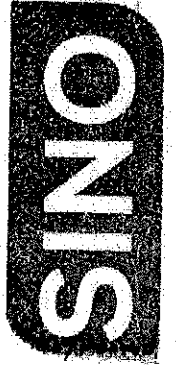

ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ
ลงชื่อ.....ผู้จะขาย
ลงชื่อ.....เจ้านาย
ลงชื่อ.....พยาน