

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม.....

ตำบล/แขวง.....แขวงนาง.....อำเภอ/เขต.....เมืองมหาสารคาม.....

จังหวัด.....มหาสารคาม.....เมื่อวันที่.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๗.....

ระหว่าง.....จังหวัดมหาสารคาม.....โดย.....นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์.....

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม.....

ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๓๑๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖.....

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ.....บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด.....

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.กรุงเทพมหานคร.....

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่.....๓๓๖๖/๑๓-๑๔.....ถนน.....พระราม ๔.....

ตำบล/แขวง.....คลองตัน.....อำเภอ/เขต.....คลองเตย.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....

โดย.....นายเปรม หวังทวีวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายโกสินทร์ ยงยศันธร.....

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....กลาง.....

(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗).....

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แนนท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้ขาย.....

เป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....

ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง.....

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายกล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๑,๗๔๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ยี่ห้อ KARL STORZ
ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมนี ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๑๗,๖๒๖.๑๗ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....ผู้ขาย



(นายเปรม หวังทวีวงศ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักวิชาการพัสดุ

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก...๒...

ในกรณีที่เป็นการซื้อขายซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๓ หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ แคตตาล็อก	จำนวน ๒๓ หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ ใบชี้แจงและยืนยันการเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๓.๕ ผนวก ๕ แผนการทำงาน	จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อคำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบและการติดตั้ง

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม..... ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาหรือภายในวันที่ ๒๕.....เดือน สิงหาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๗..... ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้พร้อมทั้งหีบห่อเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม..... ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า.....๗.....(...เจ็ด.....) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายเปรม-หวังทวีวงศ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักวิชาการพัสดุ

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อ..... ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)..... สาขา..... บิ๊กซี พระราม ๔.....
ชื่อบัญชี..... บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด..... ประเภทบัญชี..... เงินฝากกระแสรายวัน.....
เลขที่บัญชี..... ๑๙๒-๖-๐๐๓๓๔-๙..... ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใด เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก จำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือ หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนดแล้วแต่กรณี)

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาเป็นเวลา ๒ (สอง.....) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาโดย ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งาน ตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕..... (สิบห้า.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายใน กำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็น ผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้ จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเองหรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญญา คำพอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายเปรม หวังทวีวงศ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักวิชาการพัสดุ

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น.....หนังสือค้ำประกันสัญญาของ.....
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๒๕ เลขที่ ๑๐๐๖๘๑๖๕๗๘
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๙,๙๐๐.- บาท (แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....๕.....(ห้า.....) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน ให้ทราบตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขาย
พ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบ
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขาย
ส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะทำให้เกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน.....๓.....(สาม.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว
หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อสิทธิบอกเลิก
สัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม
(ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อ
สิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณีภายในกำหนด.....๑.....(หนึ่ง...) เดือน
นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายเปรม ทั่วทั้งวิวงศ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักวิชาการพัสดุ

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ...๐.๒๐..... (...ศูนย์จุดสองศูนย์.....) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด....๓๐.....(สามสิบ.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด....๓๐.....(สามสิบ.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าส่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน...๑๕.....(สิบห้า.....) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายเปรม หวังทวีวงศ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักวิชาการพัสดุ

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศ จะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ.....พยาน

(นางกัญดา คำพอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายเปรม หวังทวีวงศ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวาสนา ไชยงาม)

นักวิชาการพัสดุ

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด เลขที่ ๓๓๖๖/๑๓-๑๔ ถนน พระรามแขวง คลองตัน เขต คลองเตยจังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๙-๑๔๘๖ โดย นายเปรม หวังทวีวงศ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๔๖/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบ
๑	กล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูก และกล้องเสียง โรงพยาบาล มหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม	-	๑ เครื่อง	๑,๗๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑,๗๙๘,๐๐๐.๐๐	

(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่

ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด รับผิดชอบการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้อื่นขอเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือจังหวัด อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ จังหวัด

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัท/นิติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับทางหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙:๑๙:๑๓ น.

(นายเปรม หวังทวีวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๗๐๓๙๔๐๘๐๒๕

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๔๑๖๐๐๐๔๕๓๖

รหัสอ้างอิง OTP rWzf

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๒๒๐๐๘๓๒๕

คุณลักษณะเฉพาะ กล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

1. ความต้องการ กล้องส่องตรวจและรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง
3. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

- 3.1 เครื่องควบคุมสัญญาณภาพ ความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง
 - 3.1.1 ภายในตัวเครื่องมีหน่วยความจำ 50 GB และสามารถเสียบ USB บันทึกภาพและวิดีโอผ่าตัดได้
 - 3.1.2 รองรับการเชื่อมต่อหัวกล้องได้หลากหลายทั้งแบบ Rigid และ Flexible
 - 3.1.3 สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้
 - 3.1.4 สามารถป้อนข้อมูลคนไข้ได้
 - 3.1.5 รองรับการใช้งานกับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 VAC, ที่ความถี่ 50/60 Hz
 - 3.1.6 ความละเอียดภาพ ระดับ Full HD
- 3.2 หัวกล้องรับภาพ ความละเอียดสูง จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.2.1 มีปุ่มควบคุมบนหัวกล้อง
 - 3.2.2 มีแหวนหมุนสำหรับปรับโฟกัสภาพได้ (focusing ring / knob)
 - 3.2.3 ภายในหัวกล้อง มีอุปกรณ์รับภาพ (image sensor)
 - 3.2.4 อัตราส่วนการถ่ายทอดสัญญาณภาพ (image format) 16:9
 - 3.2.5 อัตราการส่งสัญญาณภาพที่ความถี่ (image refresh rate) ที่ 50 Hz หรือ 60 Hz ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
 - 3.2.6 สามารถทำการฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธีอบแก๊ส EO, STERRAD, STERIS, แสง Cidex ลงชื่อ.....ผู้ขาย
 - 3.2.7 หัวกล้องมีน้ำหนักเบา (lightweight) จับถือถนัดและสะดวก ลงชื่อ.....พยาน
 - 3.2.8 ให้ภาพความละเอียดสูงระดับ Full HD และภาพคมชัด ลงชื่อ.....พยาน
- 3.3 เครื่องกำเนิดแสง LED จำนวน 1 เครื่อง
 - 3.3.1 หลอดไฟชนิด LED มีอายุการใช้งานของหลอด (lamp life time) ประมาณ 30,000 ชั่วโมง
 - 3.3.2 ให้แสงกำลังสูง (powerful light) สามารถใช้กับการส่องกล้องทางการแพทย์ได้หลากหลาย (adopted in various fields of medical endoscopy)
 - 3.3.3 สามารถปรับเพิ่มหรือลดแสงได้
 - 3.3.4 ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 VAC
- 3.4 สายนำแสงชนิดไฟเบอร์ออปติก (fiber optic light cable) จำนวน 1 เส้น
 - 3.4.1 ข้อต่อสายนำแสงเป็นรูปทรงตรง (straight connector)
 - 3.4.2 เป็นสายนำแสงชนิดไฟเบอร์ออปติก (fiber optic light cable) แบบทนความร้อนพิเศษ (extremely heat-resistant)



- 3.4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายนำแสงขนาด 3.5 มิลลิเมตร
- 3.4.4 ความยาวใช้งาน 230 เซนติเมตร
- 3.4.5 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำได้
- 3.5 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ septum แบบ BECKER-CAPLAN ปลายปากทั้งสองด้าน จำนวน 1 ชิ้น
ความยาวใช้งาน 9.5 เซนติเมตร
- 3.6 อุปกรณ์แซะเนื้อเยื่อพร้อมท่อดูดของเหลว ความยาว 19 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.7 อุปกรณ์ขบตัดแบบ HEUWIESER ปลายโค้งลง 90 องศา ตัดกลับหลัง จำนวน 1 ชิ้น
ปากอ้าได้ 120 องศา ความยาว 10 เซนติเมตร
- 3.8 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบ HEYMANN ขนาดกลาง ความยาวใช้งาน 9.5 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.9 อุปกรณ์ถ่างจุกแบบ COTTLE ความยาวปากถ่าง 55 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
ความยาวใช้งาน 13 เซนติเมตร
- 3.10 ปากคีบเนื้อเยื่อในโพรงจุก แบบ BLAKESLEY ปลายตรง จำนวน 1 ชิ้น
ปลายปากเป็นชนิดตัดผ่าน (through cutting) ปลายปากกว้าง 3.5 มิลลิเมตร
ความยาวใช้งาน 11 เซนติเมตร
- 3.11 ปากคีบเนื้อเยื่อในโพรงจุก แบบ BLAKESLEY ปลายปากยกขึ้นทำมุม 45 องศา จำนวน 1 ชิ้น
ปลายปากเป็นชนิดตัดผ่าน (through cutting) ปลายปากกว้าง 3.5 มิลลิเมตร
ความยาวใช้งาน 11 เซนติเมตร
- 3.12 อุปกรณ์แซะเนื้อเยื่อแบบ MASING ปลายด้านหนึ่งคม อีกด้านหนึ่งมน จำนวน 1 ชิ้น
ความยาวใช้งาน 22.5 เซนติเมตร ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
- 3.13 อุปกรณ์แซะเนื้อเยื่อแบบ FULEIHAN ปลายด้านหนึ่งแบบ JOSEPH อีกด้านหนึ่งมน จำนวน 1 ชิ้น
ความยาว 22.5 เซนติเมตร ลงชื่อ.....ผู้ขาย
- 3.14 อุปกรณ์แซะเนื้อเยื่อแบบ COTTLE ปลายด้านหนึ่งกึ่งคม อีกด้านปลายมน จำนวน 1 ชิ้น
ความยาวใช้งาน 20 เซนติเมตร ลงชื่อ.....พยาน
- 3.15 อุปกรณ์ขบตัดเนื้อเยื่อกลับหลัง ก้านหมุนได้รอบทิศ 360 องศา จำนวน 1 ชิ้น
ความยาวใช้งาน 10 เซนติเมตร
4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
- 4.1 จอภาพ ความละเอียดระดับ Full HD แบบ Medical grade ขนาด 27 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
- 4.2 รถเข็นวางเครื่องมือและจอภาพ จำนวน 1 คัน
- 4.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง



5. เงื่อนไขเฉพาะ


- 5.1 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
- 5.2 มีเอกสารรับรองว่ามีช่างที่ผ่านการอบรมและสามารถซ่อมเครื่องได้
- 5.3 บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ชำนาญไปติดตั้งพร้อมอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้ดี

6. กำหนดระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา 2 ปี นับถัดจาก วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

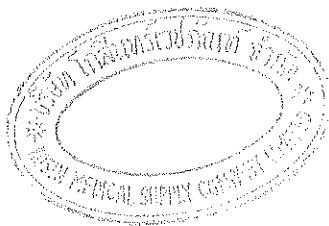

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน





3.1. TELECAM C3





The TELECAM C3 is a FULL HD camera control unit for positioning on an endoscopy system. Due to the possibility of connecting a wide range of diverse rigid, flexible and single-use endoscopes from KARL STORZ, this camera control unit is suitable for use in almost all surgical disciplines. The TELECAM C3 can be utilized in the doctor's office as well as in the surgical environment.

- 3.1.6 • FULL HD camera control unit
- 3.1.2 • Wide range of compatible rigid, flexible and single-use endoscopes from KARL STORZ
- 3.1.4 • Patient data entry possible
- 3.1.1 • Data storage on internal memory (up to 50 GB) or external storage medium
 - Improved* menu navigation thanks to newly developed navigation interface
*in comparison to previous model
- 3.1.3 • Video and photo recording features via keyboard/camera head

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
ลงชื่อ.....ผู้ขาย



Accessories

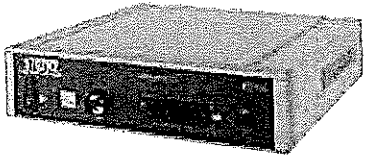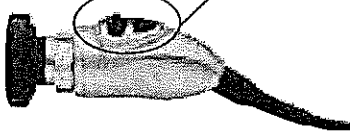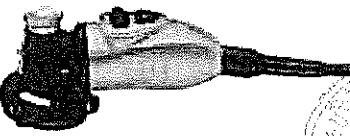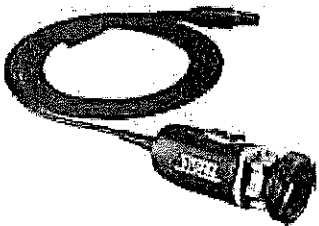
	3.1 TC100EN*	TELECAM C3 Camera control unit with 2 camera inputs (X-LINE and C-LINE), for use with flexible videoendoscopes and one-chip camera heads (up to FULL HD), with digital Image Processing Module and USB storage option, power supply 100-120 VAC/200-240 VAC, 50/60 Hz including: Mains Cord , length 300 cm DVI-D Connecting Cable , length 300 cm USB Flash Drive , 32 GB USB Silicone Keyboard , with touchpad, US	3.1.1 3.1.5
	3.2 TH110	IMAGE1 S™ HX One-chip FULL HD camera head, 50/60 Hz, fixed focus, progressive scan, soakable, gas- and plasma-sterilizable, focal length $f = 16$ mm, 2 freely programmable camera head buttons, for use with IMAGE1 S™ X-LINK TC301, TELE PACK+ TP101 and TELECAM C3 TC100	ผู้ซื้อ
	TH111	IMAGE1 S™ HX-P One-chip FULL HD pendulum camera head, 50/60 Hz, with pendulum system and fixed focus, progressive scan, soakable, gas- and plasma-sterilizable, focal length $f = 16$ mm, 2 freely programmable camera head buttons, for use with IMAGE1 S™ X-LINK TC301, TELE PACK+ TP101 and TELECAM C3 TC100	ผู้ขาย พยาน พยาน
	TH130	H1 Camera Head One-chip HD camera head, progressive scan, low-temperature sterilization, focal length $f = 19$ mm, 2 freely programmable camera head buttons in combination with TELE PACK+ or TELECAM C3, for use with TELE PACK+ TP101, TELECAM C3 TC100, C-HUB® II 20290320 and C-MAC® Monitor for CMOS Endoscope 8403ZX	

* Also available in the following languages: DE, ES, FR, IT, PT, RU, SE




3.2.2

3.2.1

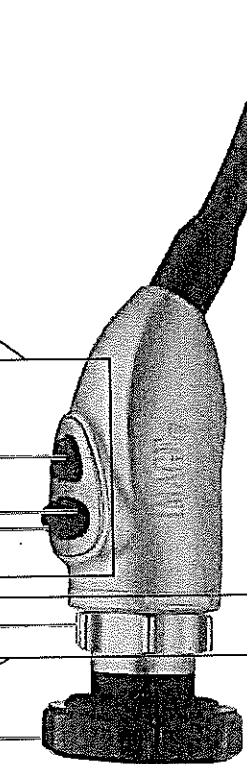

TH 110 HX

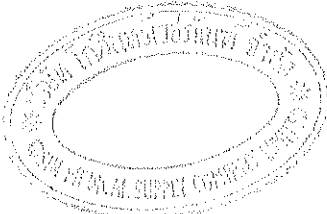


TH 111 HX-P

- ① Instrumentenkupplung
- ② Fokusing/-rad
- ③ Bedientaste: Scrollen im Menü (nach oben) oder Aktivieren einer Kamerafunktion
- ④ Bedientaste: Aufrufen des Menüs/Auswählen
- ⑤ Bedientaste: Scrollen im Menü (nach unten) oder Aktivieren einer Kamerafunktion

- ① Instrument coupler
- ② Focusing ring/knob
- ③ User control button: for scrolling (upwards) through the menu or activating a camera function
- ④ User control button: for accessing the menu/making a selection
- ⑤ User control button: for scrolling (downwards) through the menu or activating a camera function

- ① Acoplamiento para instrumentos
- ② Anillo/rueda de enfoque
- ③ Botón de control: desplazamiento en el menú (hacia arriba) o activación de una función de la cámara
- ④ Botón de control: llamada del menú/selección
- ⑤ Botón de control: desplazamiento en el menú (hacia abajo) o activación de una función de la cámara

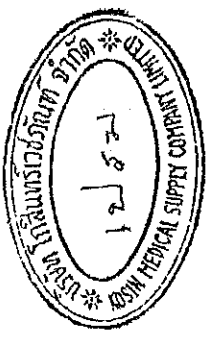

Technische Beschreibung

Technical description

Descripciones técnicas

6 Technische Beschreibung

6 Technical description

6 Descripciones técnicas

6.1 Technische Daten



6.1 Specifications

6.1 Datos técnicos

IMAGE1 HX-Kameraköpfe	
Bildsensor	1/3"
Bildformat	16:9
Bildwiederholrate	50 Hz/60 Hz
Brennweite	16 mm
Abmessungen (L x H x B)	100 mm x 36 mm x 35 mm
Gewicht	TH 110: 130 g TH 111: 142 g

IMAGE1 HX camera heads	
Image sensor	1/3"
Image format	16:9
Image refresh rate	50 Hz/60 Hz
Focal length	16 mm
Dimensions (L x H x W)	100 mm x 36 mm x 35 mm
Weight	TH 110: 130 g TH 111: 142 g

Cabezales de la cámara IMAGE1 HX	
Sensor de imagen	1/3"
Formato de imagen	16:9
Frecuencia de la imagen	50 Hz/60 Hz
Distancia focal	16 mm
Dimensiones (la x al x an)	100 mm x 36 mm x 35 mm
Peso	TH 110: 130 g TH 111: 142 g

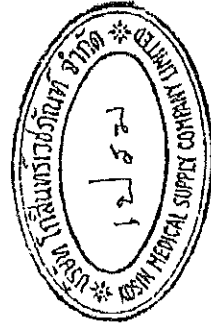

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย



ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

IMAGE1 S™ HX ^{NEW}

One-Chip FULL HD Camera Heads

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

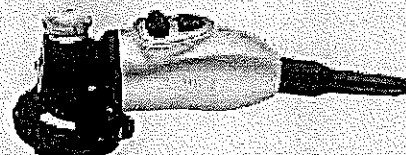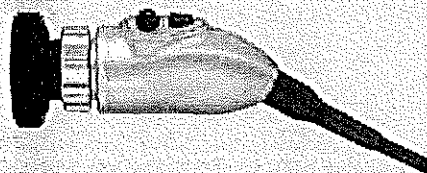

Pendulum System

	3.2 TH 110 IMAGE1 S™ HX* One-Chip FULL HD Camera Head	TH 111 IMAGE1 S™ HX-P* One-Chip FULL HD Pendulum Camera Head
For use with:	● IMAGE1 S™ X-LINK, module for one-chip camera heads and flexible endoscopy	

Specifications:


Frame rate	3.2.3	50/60 Hz 3.2.5
Image sensor		1-chip 3.2.8
Resolution		1920 x 1080 pixels
Scanning method		progressive scan
Lens	fixed focus	pendulum system, fixed focus
Focal length		f = 16
Dimensions w x h x l	3.2.7	35 x 36 x 100 mm
Weight	130 g	142 g
Cable length		300 cm
Cable routing	angled	straight
Camera head buttons		freely programmable
Grip mechanism		standard eyepiece adaptor
Reprocessing		soakable, EO sterilization, H ₂ O ₂ (hydrogen peroxide) 3.2.6
Degree of protection		In conjunction with Camera Control Unit IMAGE1 S™: CF-Defib

* No S-Technologies available



10-18

Cold Light Fountain LED NOVA 150

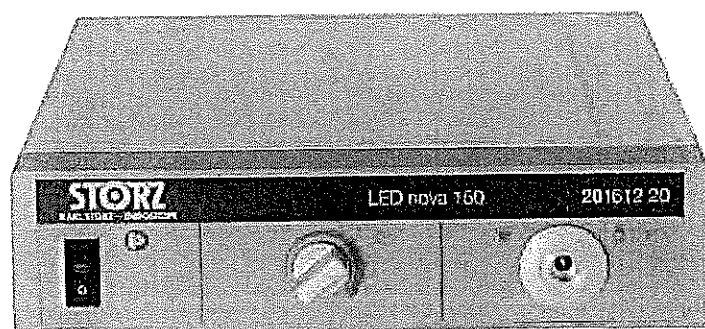


3.3
201612 01

Cold Light Fountain LED NOVA 150,
power supply 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
including:
Mains Cord

3.3.4



Cold Light Fountain Power LED 175

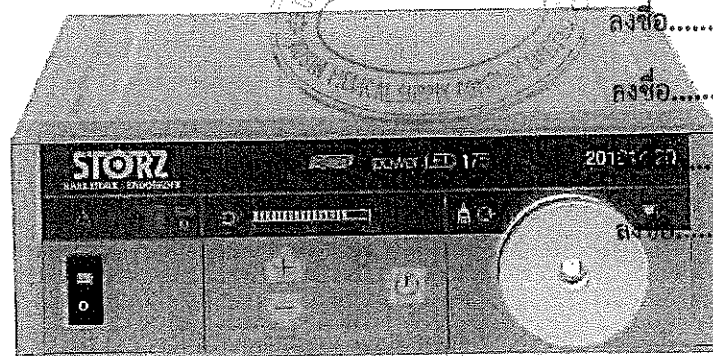

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
ลงชื่อ.....ผู้ขาย
.....พยาน
.....พยาน

201614 01-1 Cold Light Fountain Power LED 175 SCB,
power supply 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
including:
Mains Cord
SCB Connecting Cable, length 100 cm



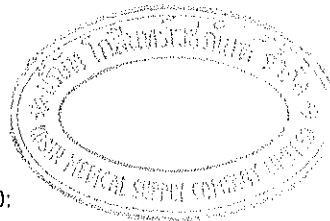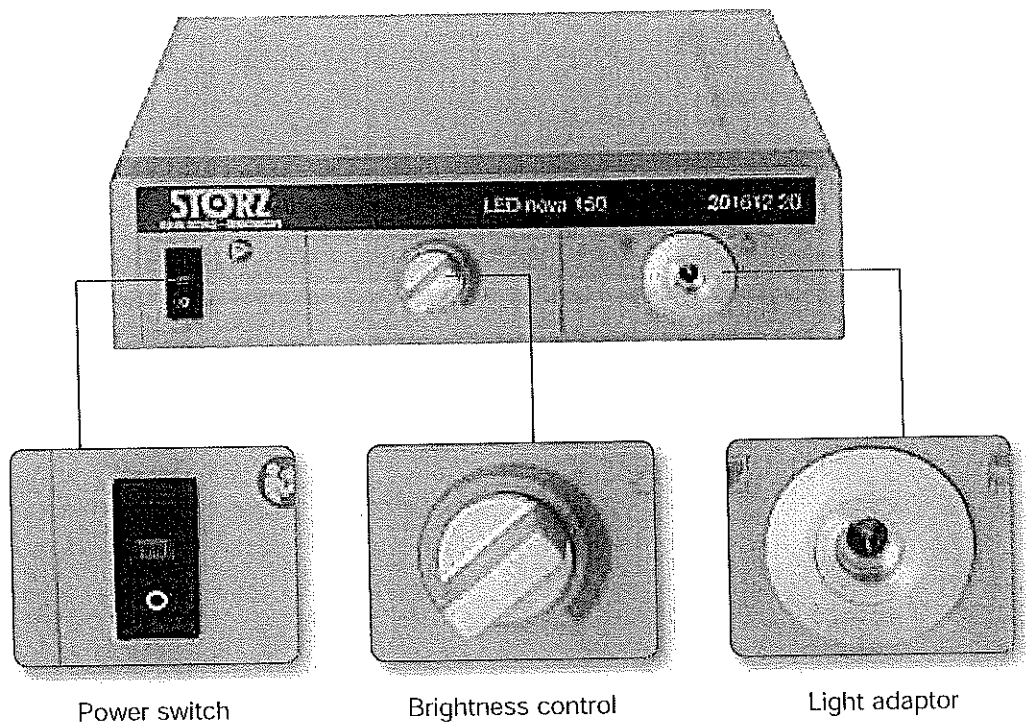

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
 ลงชื่อ.....ผู้ขาย
 ลงชื่อ.....พยาน


Advantages of LED NOVA 150:

- Very economic, thanks to attractive purchase price and low operating costs
- 3.3.1** • Very long, average lamp life of 30,000 hours requires almost no lamp changes
- Extremely quiet operation with low heat generation; ideal for use in private practice
- Natural color rendition with much higher, more homogenous illumination
- 3.3.3** • Infinitely variable brightness control for fine adjustments
- 3.3.2** • Very high energy efficiency thanks to newest LED technology
- Environmentally friendly and easy to recycle as LEDs are free of lead and mercury



Fiber Optic Light Cables

for Cold Light Fountains

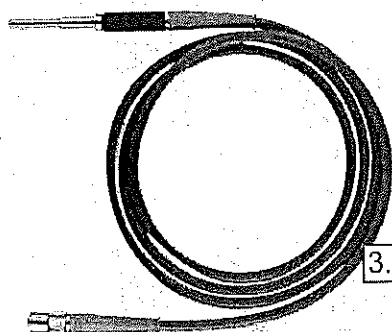

3.4

3.4.1

Fiber Optic Light Cable with Straight Connector

- 495 NL Fiber Optic Light Cable, diameter 3.5 mm, length 180 cm
- 495 NA Fiber Optic Light Cable, diameter 3.5 mm, length 230 cm
- 495 ND Fiber Optic Light Cable, diameter 3.5 mm, length 300 cm
- 495 NB Fiber Optic Light Cable, diameter 4.8 mm, length 180 cm

3.4.3


- 495 NCSC Fiber Optic Light Cable, extremely heat-resistant, diameter 4.8 mm, length 250 cm

3.4.4

- 495 NE Fiber Optic Light Cable, diameter 4.8 mm, length 300 cm
- 495 NT Fiber Optic Light Cable, diameter 2.5 mm, length 180 cm
- 495 NTA Fiber Optic Light Cable, diameter 2.5 mm, length 230 cm


3.4.5

Autoclavable



Light Adaptor, 90° angled

- 495 EW Light Adaptor, angled 90°, diameter 4.8 mm, free rotatable to connect with standard telescopes



Fiber Optic Light Cable with 90° Deflection to the Light Source

- 495 NW Fiber Optic Light Cable, with 90° deflection to the cold light fountain on the fountain side, diameter 3.5 mm, length 180 cm
- 495 NTW Fiber Optic Light Cable, with 90° deflection to the cold light fountain on the fountain side, diameter 2.5 mm, length 180 cm
- 495 NWM Fiber Optic Light Cable, with 90° deflection to the cold light fountain on the fountain side, diameter 3.5 mm, length 230 cm
- 495 NTX Fiber Optic Light Cable, with 90° deflection to the cold light fountain on the fountain side, diameter 2.5 mm, length 230 cm
- 495 NWL Fiber Optic Light Cable, with 90° deflection to the cold light fountain on the fountain side, diameter 3.5 mm, length 300 cm

LIGHT SOURCES



Fiber Optic Light Cable with 90° Deflection to the Instrument

- 495 NV Fiber Optic Light Cable, with 90° deflection to the instrument, diameter 3.5 mm, length 230 cm
- 495 NVL Fiber Optic Light Cable, with 90° deflection to the instrument, diameter 3.5 mm, length 300 cm


Adaptor for connecting KARL STORZ fiber optic light cables with endoscopes and light sources from other manufacturers see pages TP 108-109



9-01

Nose

Instruments for Rhinology and Rhinoplasty

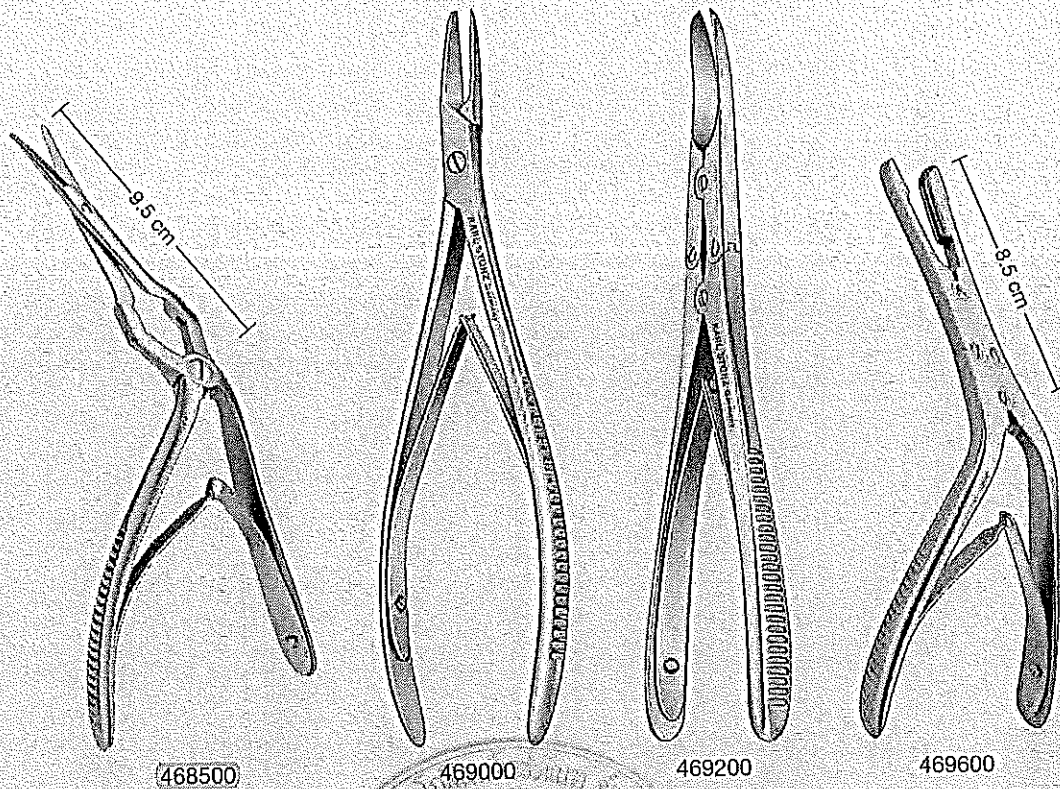

3.5 468500

BECKER-CAPLAN Septum Scissors, double action jaws, serrated, working length 9.5 cm

469000

KAZANJIAN Forceps, length 20 cm

469200

ROWLAND-MEYER Nasal Hump Forceps, double action jaws, curved blades, length 20 cm

469600

RUBIN Septum Morcelizer, with double joint, working length 8.5 cm


ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
ลงชื่อ.....ผู้ขาย
.....พยาน
.....พยาน



Nose

Instruments for Rhinology and Rhinoplasty

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

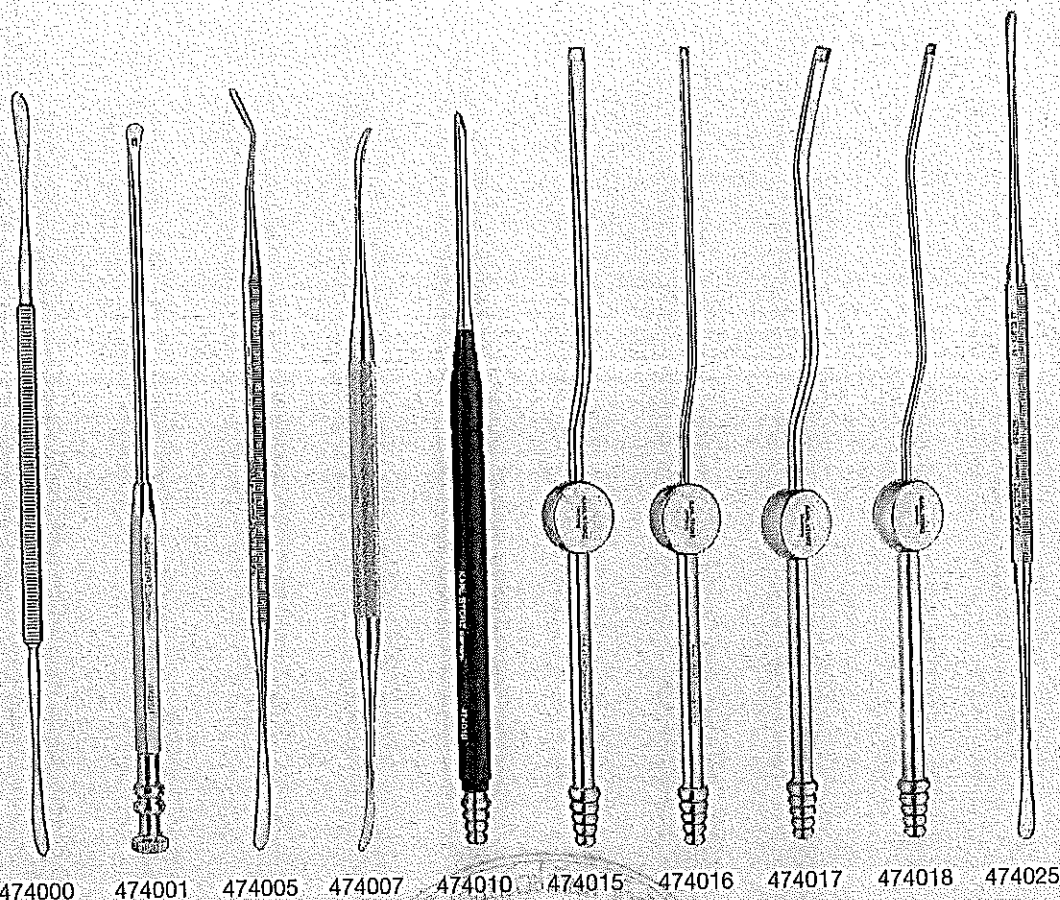

- | | | |
|------------|--|---------|
| 474000 | FREER Elevator, double-ended, semisharp and blunt, length 20 cm | ผู้ซื้อ |
| 3.6 474001 | FREER Suction Elevator, with stylet, length 19 cm | ผู้ขาย |
| 474005 | FREER-JACOBS Elevator, double-ended, semisharp, one side slightly curved FREER elevator, width 5 mm, other side JACOBS elevator, angled 45°, width 2.5 mm, length 20 cm, for infundibulotomy | พยาน |
| 474007 | FREER-YASARGIL Elevator, double-ended, length 18.5 cm | พยาน |
| 474010 | HARALDSSON Suction Elevator, with rotatable tube olive, length 19 cm | |
| 474015 | CASTELNUOVO Suction Elevator, flat tip, 5 x 1.8 mm, lateral suction opening, bayonet-shaped, with grip plate, length 21 cm | |
| 474016 | Same, flat tip 3 x 1.8 mm | |
| NEW 474017 | CASTELNUOVO Suction Elevator, flat tip 5 x 1.8 mm, lateral suction opening, bayonet-shaped, distal end curved, with grip plate, length 21 cm | |
| NEW 474018 | Same, 3 x 1.8 mm | |
| 474025 | Elevator, double-ended, both sides sharp, length 22 cm | |



FESS Instruments


for Endoscopic Diagnosis, Surgery and Postoperative Treatment
of Nasal Sinuses and Anterior Skull Base

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

HEUWIESER Antrum Grasping Forceps

Special Features:

- Unique concept, completely new design
- Short, sharp-radius curve starting at the joint of the jaws
- Far-reaching jaws open backwards
- For endonasal removal of cysts and polyps
- Specially suitable for out-patient use under local anesthesia where a window already exists, without subjecting the patient to undue stress
- With the telescope introduced separately the slim sheath with a diameter of only 2.5 mm permits good handling and unimpeded view inside the antrum
- Distal end of the forceps is sharply curved like an antrum cannula thus making it possible to introduce the working end far into the antrum; the fundus of the antrum is reached down to the alveolar sinus
- Fenestrated jaws enable unobstructed view of anatomic structures and the position of the jaws, thus particularly facilitating localized work with grasping forceps
- Also suitable for removing fish bones and hairs from the hypopharynx




653001




653000



653002




653003



653005



653006

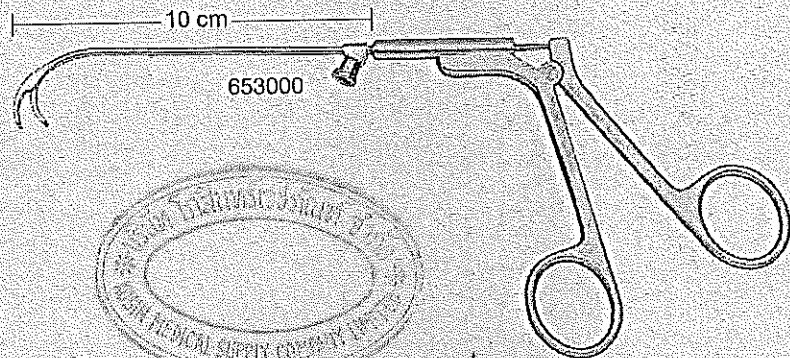

3.7

653000

HEUWIESER Antrum Grasping Forceps,
jaws curved downwards, fixed jaw curved
90°, movable jaw opening up to 120°
backward opening, with cleaning
connector, working length 10 cm

653001

Same, jaws curved upwards

653002

Same, jaws curved to right

653003

Same, jaws curved to left

653005

HEUWIESER Antrum Grasping Forceps,
with extra long curve for anterior alveolar
recess, fixed jaw curved downwards
115°, movable jaw backward opening
up to 140°, with cleaning connector,
working length 10 cm

653006


Same, fixed jaw curved downwards 140°,
movable jaw backward opening 155°

1-992





Nose


Instruments for Rhinology and Rhinoplasty

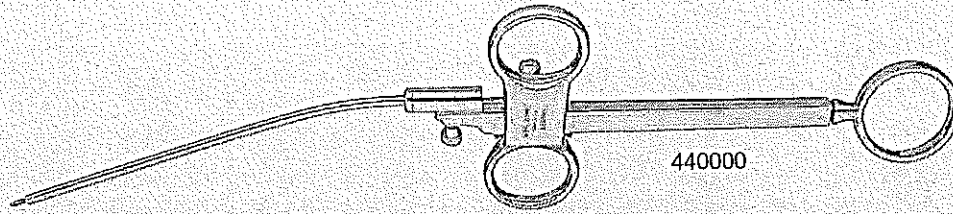


440000 KRAUSE Nasal Snare, length 25 cm

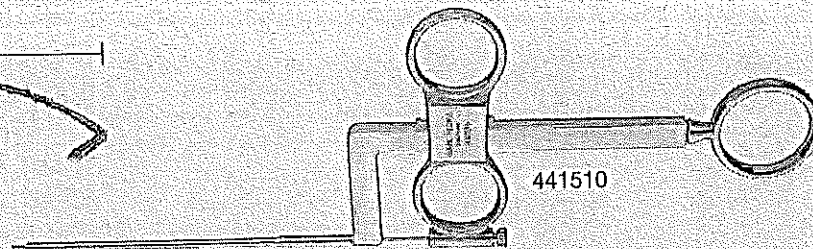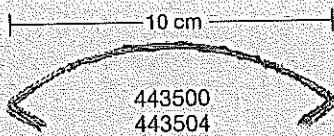


- 441510 LANGE Nasal Snare, bayonet-shaped, length 24 cm
- 443500 Nasal Snare Wire, for 440000 – 441510, standard size, diameter 0.3 mm, length 10 cm, package of 25
- 443504 Same, diameter 0.4 mm, package of 25



449012

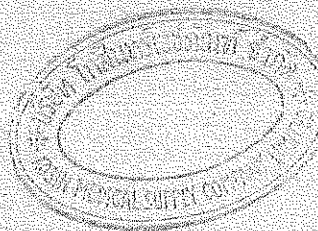

ผู้ซื้อ.....
ผู้ขาย.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

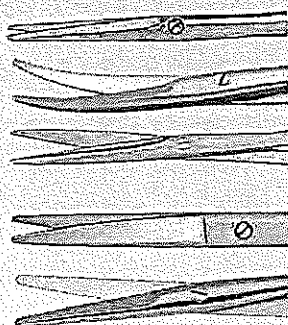

- 449001 HEYMANN Nasal Scissors, small, working length 9 cm
- 449001 L Nasal Scissors, small, curved left, working length 9 cm
- 449002 HEYMANN Nasal Scissors, medium (standard model), working length 9.5 cm
- 449003 HEYMANN Nasal Scissors, large, working length 11 cm
- 3.8 449012 HEYMANN Nasal Scissors, medium, serrated blades, working length 9.5 cm

Components/Spare Parts see chapter 16







Nose

Rhinoplasty – Aesthetic-Plastic Surgery of the Nose

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

BERGHAUS Recommended Set

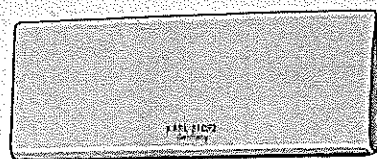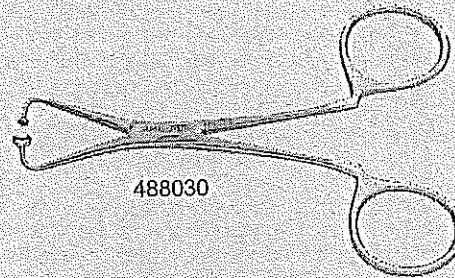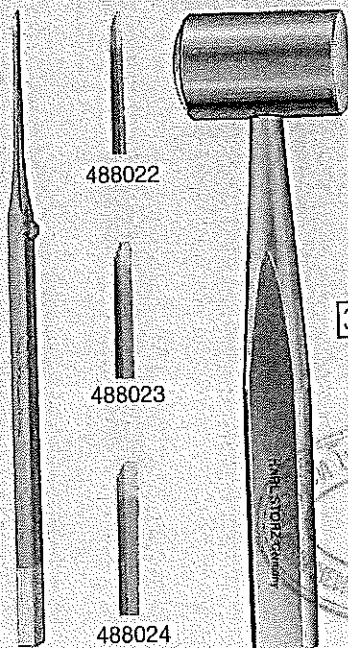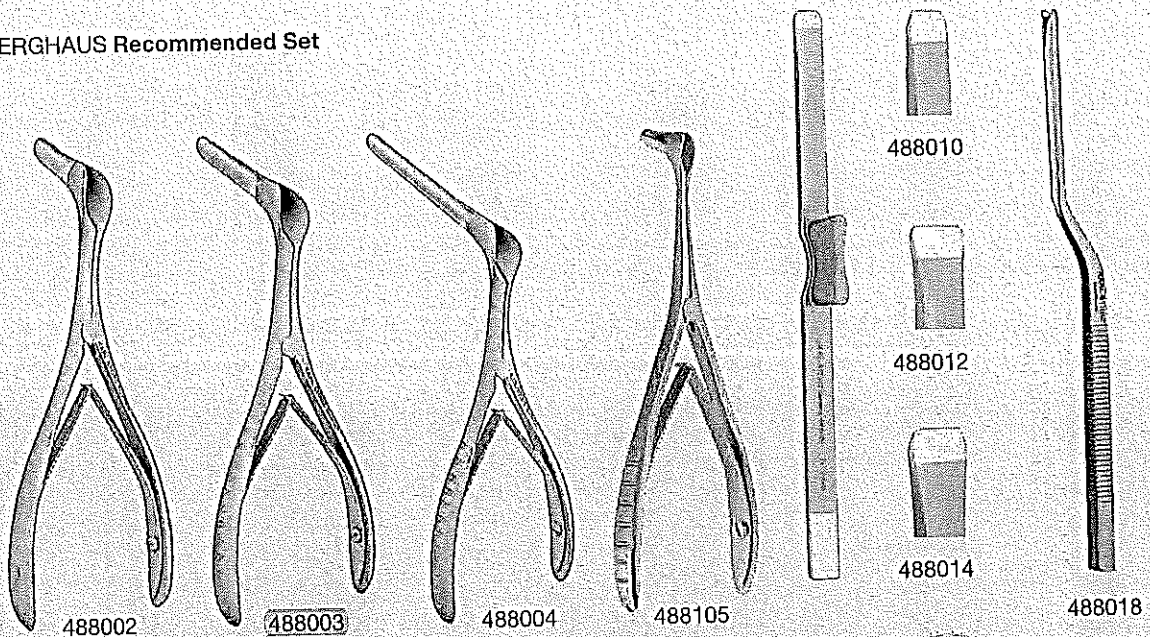

- | | | |
|--------|--|--|
| 488002 | COTTLE Nasal Speculum, extra slender, without set screw, blade length 35 mm, length 13 cm | |
| 488003 | Same, blade length 55 mm | |
| 488004 | Same, blade length 75 mm | |
| 488105 | HALLE-TIECK Nasal Speculum, for infants, length 13 cm | |
| 488010 | RUBIN Osteotome, flat, straight, double-edged grinding, rounded corners, with finger grip for controlled osteotomy guidance, width 10 mm, length 16.5 cm | |
| 488012 | Same, width 12 mm | |
| 488014 | Same, width 14 mm | |
| 488018 | KILLIAN-CLAUS Septum Chisel, with V-shaped cutting edge, width 5 mm, length 16.5 cm | |
| 488022 | Chisel, with finger button, flat, width 2 mm, length 18 cm | |
| 488023 | Same, width 3 mm | |
| 488024 | Same, width 4 mm | |
| 174200 | COTTLE Metal Mallet, length 18 cm | |
| 231000 | Hone, "ARKANSAS" oil stone, wedge-shaped, 10 x 4 cm | |
| 488030 | Marking Instrument, for nasal tip, with ball and half cup, straight, length 11 cm | |

3-99z

N 55 A




Nose

Nasal Sinuses,
Microscopic/Endoscopic Surgery
for Nasal Sinuses, Skull Base and Pituitary Surgery

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE


Nasal Forceps, working length 11 cm

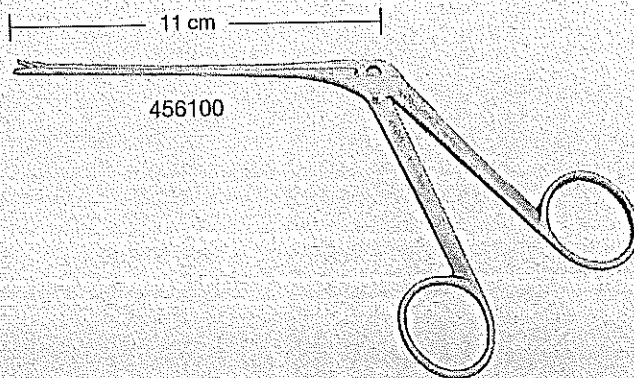

456100

Nasal Forceps, straight, through-cutting,
tissue-sparing, BLAKESLEY shape,
width 2.5 mm, working length 11 cm

3.10




456101

Same, width 3.5 mm



456102

Same, width 4.2 mm



456103

Same, width 4.8 mm



456120

Nasal Forceps, 45° upturned, through-cutting,
tissue-sparing, BLAKESLEY shape,
width 2.5 mm, working length 11 cm

3.11



456121

Same, width 3.5 mm



456122

Same, width 4.2 mm




456123

Same, width 4.8 mm

1-031

Nose

Instruments for Rhinology and Rhinoplasty

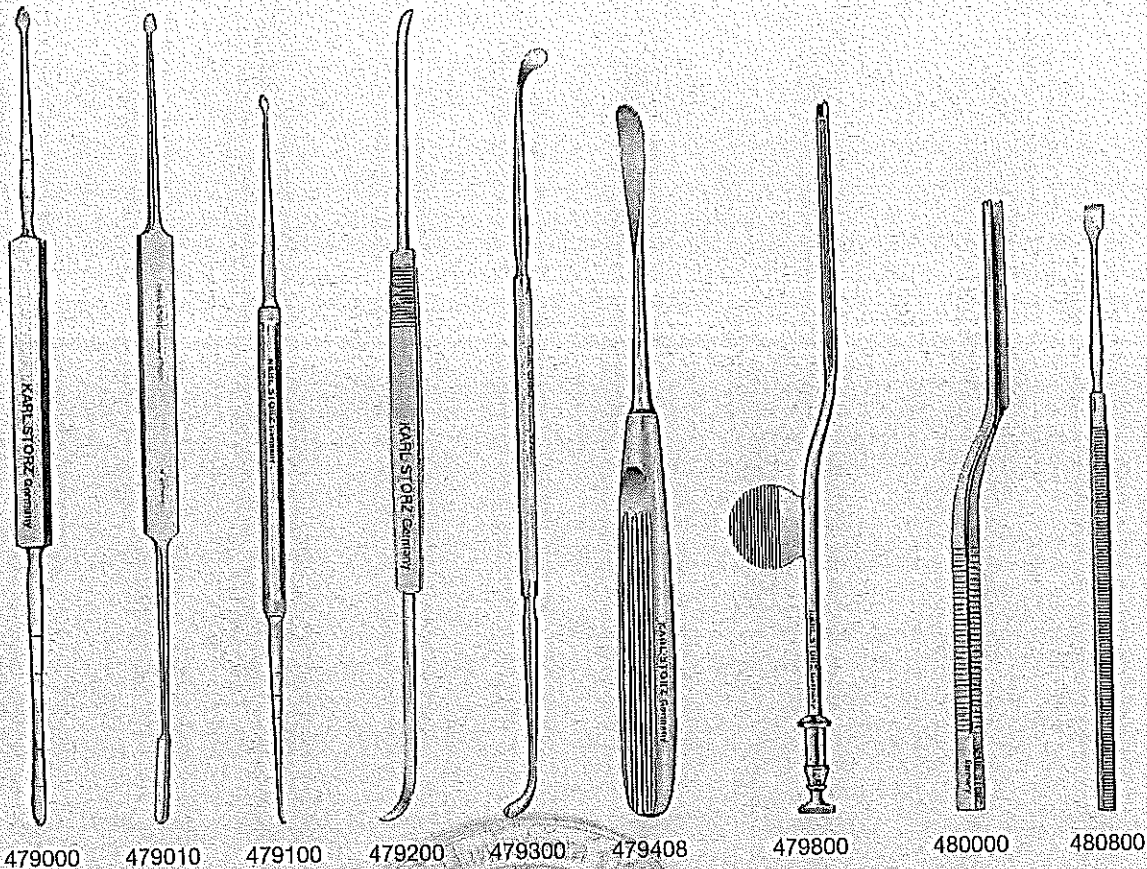

- | | | | |
|------|--------|--|---------|
| 3.12 | 479000 | MASING Elevator, double-ended; graduated, sharp and blunt, length 22.5 cm | ผู้ซื้อ |
| 3.13 | 479010 | FULEIHAN Elevator, double-ended, one end JOSEPH elevator, other end sharp, graduated, length 22.5 cm | ผู้ขาย |
| 3.14 | 479100 | COTTLE Elevator, double-ended, semisharp and blunt, graduated, length 20 cm | พยาน |
| | 479200 | COTTLE Raspatory, double-ended, for tunneling, length 22.5 cm | พยาน |
| | 479300 | PENNINGTON Elevator, double-ended, curved to the right and left, length 21 cm | |
| | 479408 | COTTLE Raspatory, slightly curved, width 8 mm, length 19.5 cm | |
| | 479800 | Suction Raspatory, with stylet, length 19.5 cm | |
| | 480000 | KILLIAN-CLAUS Septum Chisel, V-shaped cutting edge, length 16.5 cm | |
| | 480800 | FREER Septum Chisel, straight, length 16.5 cm | |

3-993

Nasal Sinuses




3.15

459096 W

459097

459099

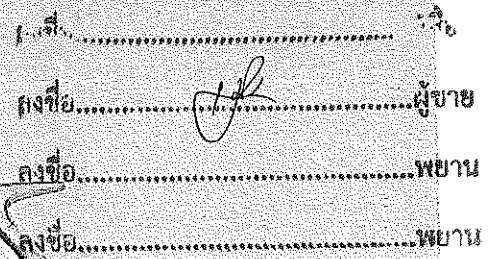

8-117

FS-L2701DT



www.fsnmed.com

FSN

27" Touch Medical Display Full HD 4.1

FSN's 27" touchscreen medical display is ideal for manipulating images in multi-modality settings that incorporate endoscopic cameras, ultrasound, cardiology, room or boom cameras, patient vital signs, and more. It displays images at the highest resolution, and is compatible with major MIS camera systems in use. Enable clinical efficiency and quick OR turnaround with fast disinfection of the smooth front glass surface found on FS-L2701DT.

- Designed for the integrated operating room
- 10 point projected capacitive multi-touch screen
- 650 nits high-bright LED backlight
- Fast, near-zero latency for instantaneous image display.
- Calibrated for clinical color and gray scale reproduction
- Surgeon confidence is strengthened with clear visualization
- Compliant with RoHS requirements

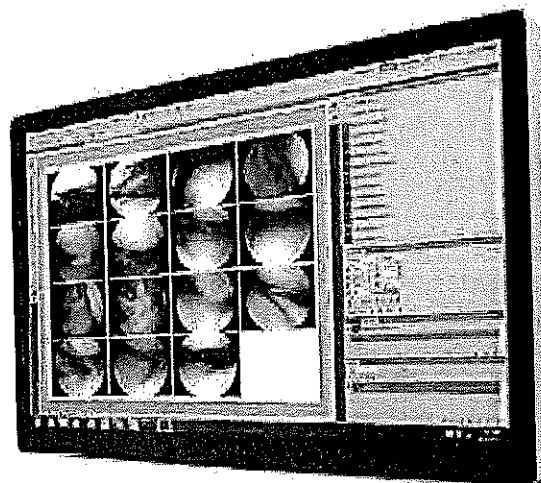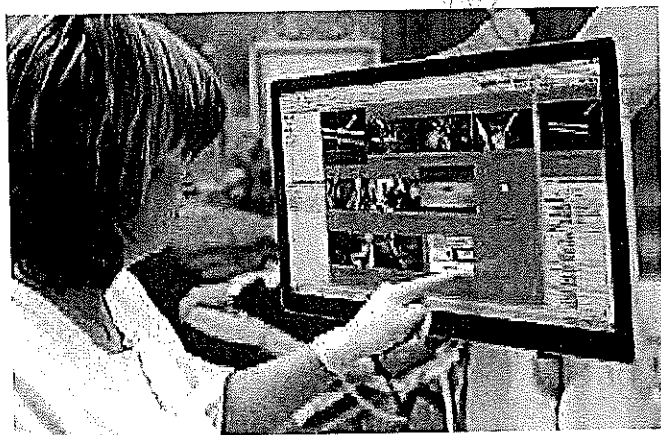


The FS-L2701DT display from FSN builds upon our long history of advanced medical-grade monitors. This new touch screen display features a slim, sleek design and a flush-front glass bezel. The screen size is large for easy manipulation of touch screen elements, yet small enough to mount on a moveable arm or boom if required.

Accurate Color Reproduction



FSN has implemented methods to fine-tune the properties of our displays. Distinct color space settings have been calibrated to well-known surgical color preferences.

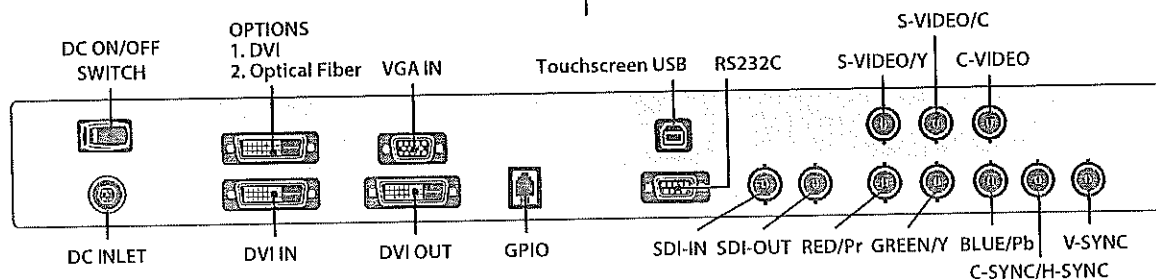

FSN displays have the connections you need. All major inputs are accepted via the back side connection panel.

Foreseon Custom Displays, Inc.
2210 E. Winston Road
Anaheim, CA 92806 USA
Tel: 714-300-0540
Fax: 714-300-0546

San Jose, CA Tel: 714-507-3851
Fort Lee, NJ Tel: 714-507-3852

Foreseon Korea
404B, PangyoInnovation Valley B
253 Pangyo-ro
Bundang-gu Seongnam-si
Gyeonggi-do, Korea 463-400
Tel: +82-31-8018-0780
Fax: +82-31-8018-0786

www.fsnmed.com

Foreseon GmbH
Industriestrasse 38a
63150 Heusenstamm, Germany
Tel: +49 6104 64398 0
Fax: +49 6104 64398 11

Foreseon UK Ltd.
Unit 71 Barwell Business Park
Leatherhead Road
Chessington Surrey KT20 7JH
Tel: +44 (0)181 606 1111

Foreseon (Shanghai)
Medical Equipment Co., Ltd.
Room 307, 3F
No. 56, 461 Honggao Road
Caojing Development District
Shanghai 200233
Tel: +86 21 5113-4188






4.2

รถเข็นวางชุดเครื่องส่องตรวจและผ่าตัด (Equipment Stand)


ชั้นวางเครื่องมือสีขาวแบบมีล้อ

คุณลักษณะ

- มีล้อแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (antistatic) จำนวน 4 ล้อ
- ล้อแต่ละชุดจะประกอบด้วยล้อ 2 ข้าง (dual wheels)
- มีชุดห้ามล้อ (locking brake)
- สามารถเก็บซ่อนสายไฟไว้ภายในแกนของรถเข็นได้ (in vertical beam)

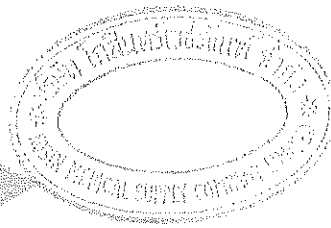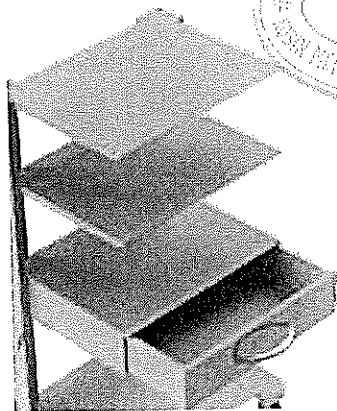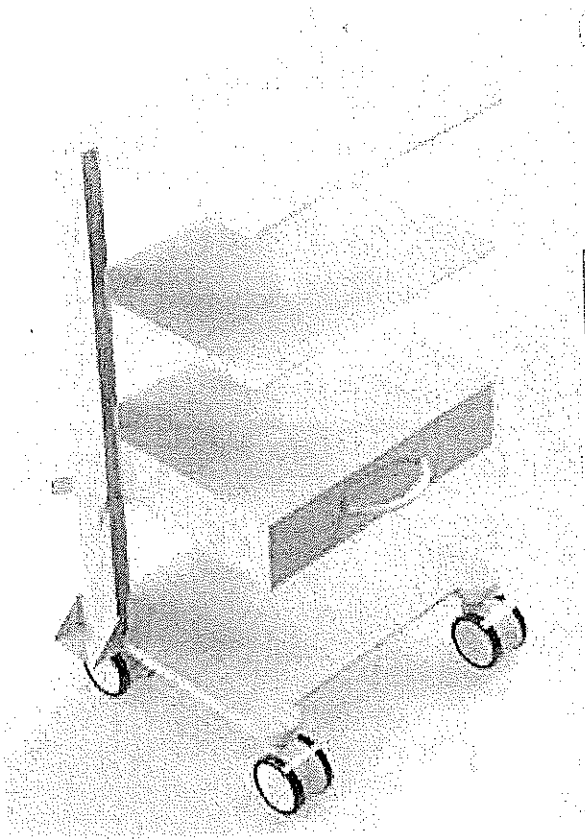

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
ลงชื่อ.....ผู้ขาย
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน

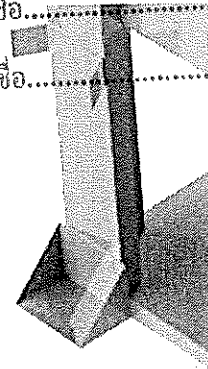

มีที่วางถังแก๊ส CO₂ ขนาด
(กว้างxสูงxลึก) 8x8x8 cm
สามารถวางถังแก๊สขนาด 1.5 ลิตร



CLEANLINE

UPS

True On-Line Double Conversion Design




Tower and 19" Rack-mount Model

T-1000, TR-1000:	1kVA/900W
T-1500, TR-1500:	1.5kVA/1,350W
T-2000, TR-2000:	2kVA/1,800W
T-3000, TR-3000:	3kVA/2,700W



KEY Features:

- True on-line double conversion design UPS
- 100% digitized microprocessor controlled
- Output power factor 0.9
- Wide input voltage range 110-300Vac
- 50/60 Hz frequency converter mode
- MIMIC LCD for real-time UPS status display
- Auto self-testing system while turning on UPS
- ECO mode operation for energy saving
- Emergency power off (EPO) function
- Programmable power management outlets
- Selectable output voltage via LCD panel
- Cold start function
- Smart battery charger design to optimize battery performance
- Battery charger with temperature compensation technology
- Short circuit protection
- Lightning and surge protection
- Built-in USB and RS-232 communications port for management software
- Generator compatible
- Optional external maintenance bypass switch
- Optional compatible with SNMP protocol
- UPS Monitoring and Controlling Software, Available for immediate download via the website

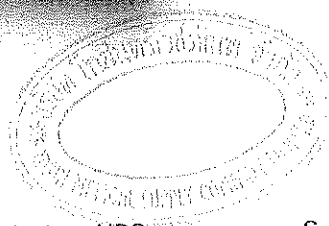

CERTIFICATE

Wir bestätigen die Teilnahme von /
we confirm participation of

KOSIE YONGYUKANTORN

Kursname / course name

Basic&Advanced Training Courses
for Service Technicians

05-20.08.2019

im / at
Training Center Tuttlingen


ลงชื่อ.....ผู้ถือ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

Tuttlingen, 21.08.2019

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

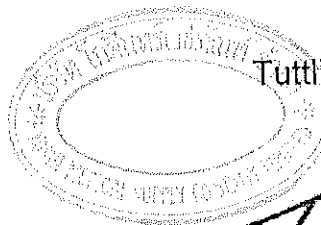

Thomas Bürger

i.A. Thomas Bürger
KARL STORZ SE & Co. KG
Director Training & Education
Product Marketing




STORZ
KARL STORZ - ENDOSKOPE

58235068 E

Training Contents

- 1) Repairs Electronic Equipment
- 2) Installation Procedures
- 3) Troubleshooting of Devices
- 4) Tray Audit
- 5) OR1 Installation

KARL STORZ solution value chain
Interactive Visitor Centre tour

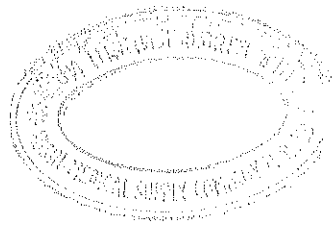

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
ลงชื่อ.....ผู้ขาย
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน



75
Years

Shaping the Future of Endoscopy with you

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

KARL STORZ SE & Co. KG • PO Box 230 • 78503 Tuttlingen/Germany

Mr. Kosie Youngyukantorn
Kosin Medical Supply Company, Ltd



Your ref.

Date of your letter

Our ref.
LSTA

Date
13.05.2020

Dear Kosie,

Manufacturer declaration: "Certificate of supplying spare parts"

We, KARL STORZ SE & Co. KG, hereby certify that we will keep spare parts and consumables available for 5 years after shipment of goods. We reserve the right to exchange parts or complete units if necessary due to technical progress.


We hope that this will help in your matter and we look forward to many more years of amicable cooperation

Yours sincerely,

KARL STORZ SE & Co. KG

C. Stärk

i.A. Linus Stärk
Service
Technical Coordinator

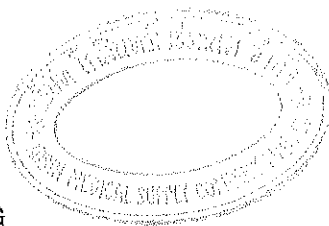

ลงชื่อ.....ผู้ขาย
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน



Office Address:
KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany
Phone: +49 7461 700-0
Fax: +49 7461 700-105
E-Mail: info@karl-storz.com
www.karl-storz.com

Bank Accounts:
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG
SWIFT: GENO DES11TUT
IBAN: DE97 6439 0130 0000 7720 03
Commerzbank AG Tuttlingen
SWIFT: COBA DE FF 643
IBAN: DE09 6438 0011 0271 3305 00

Kreissparkasse Tuttlingen
SWIFT: SOLA DES 1 TUT
IBAN: DE79 6435 0070 0000 0013 22
Deutsche Bank AG Tuttlingen
SWIFT: DEUT DES555
IBAN: DE09 0537 0075 0211 6390 00

Limited Partnership:
KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany
Place of Business: Tuttlingen
Commercial Register:
Stuttgart HRA 150142
VAT-ID-No. DE 142931059
WEEE Reg.-No. DE 74485858

Unlimited Partner:
KARL STORZ Verwaltungs SE
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany
Place of Business: Tuttlingen
Commercial Register: Stuttgart HRA 762524
Managing Director:
Karl-Christian Storz
Chair of the Supervisory Board:
Dr. h. c. mult. Sybille Storz

KARL STORZ SE & Co. KG • PO Box 230 • 78503 Tuttlingen/Germany

To whom it may concern

Your ref.

Date of your letter

Our ref.


Date

22.12.2023

AUTHORIZATION LETTER

We, KARL STORZ SE & Co. KG, hereby certify that the company

Kosin Medical Supply Co. Ltd.
3366/13-14, Soi Manorom
Rama 4 Road, Klong Ton
Klong Toey
10110 Bangkok
Thailand

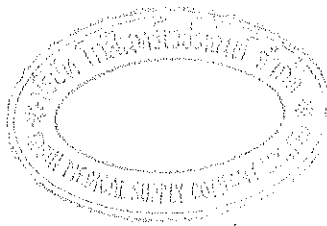


ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
ลงชื่อ.....ผู้ขาย
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน

is appointed as our exclusive authorized distributor in Thailand, according to the valid distributorship contract.

This Authorization Letter is valid until December 31, 2024, subject to revocation prior to this.

Best regards

KARL STORZ SE & Co. KG

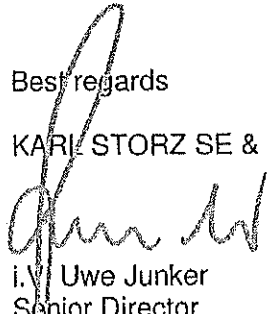
i. V. Uwe Junker
Senior Director
Global Order Management



Office Address:
KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany
Phone: +49 7461 708-0
Fax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

Bank Accounts:
UniCredit Bank AG
SWIFT: HYVEDENM473
IBAN: DE62 6002 0290 0034 5326 05
Kreissparkasse Tuttlingen
SWIFT: SOLADES1TUT
IBAN: DE79 6435 0070 0000 0013 22

Deutsche Bank AG Tuttlingen
SWIFT: DEUTDE33HAN
IBAN: DE09 6537 0075 0211 6390 00
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG
SWIFT: GENODES1TUT
IBAN: DE97 6439 0130 0000 7720 03

Limited Partnership:
KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany
Place of Business: Tuttlingen
Commercial Register:
Stuttgart HRA 450442
VAT-ID-No. DE 142931059
WEEE Reg.-No. DE 74465858

Unlimited Partner:
KARL STORZ Verwaltungs SE
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany
Place of Business: Tuttlingen
Commercial Register: Stuttgart HRB 762524
Managing Director:
Karl-Christian Storz
Chair of the Supervisory Board:
Dr. h. c. mult. Sybill Storz



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. ๐ ๔๓๗๑-๑๗๕๐-๔ ต่อ ๙๒๕๖

ที่ มค.๐๐๓๓.๒๐๑/๑๖๓๕

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การชี้แจงและยืนยันการเสนอราคาก่อสร้างตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง โรงพยาบาลมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอมะหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ตามที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอมะหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในวงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม และเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอมะหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในประกาศจังหวัดมหาสารคาม โดยเสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด เสนอราคาก่อสร้างตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอมะหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๙๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ยี่ห้อ KARL STORZ ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมนี

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้เรียกผู้เสนอราคามาชี้แจงและยืนยันราคา เพื่อประโยชน์ทางราชการ ปรากฏผลดังนี้

๑. บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม คือ กล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอมะหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๙๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

๒. บริษัทฯ ยินดีแถม ตามรายการดังนี้

๒.๑ อุปกรณ์ปากคีบเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อกล่องเสียง (Laryn Biopsy) จำนวน ๑ ชิ้น
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

๒.๒ อุปกรณ์ท่อดูดของเหลวพร้อมจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า (Suction Coag) แบบสั้น
จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

๒.๓ อุปกรณ์ท่อดูดของเหลวพร้อมจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า (Suction Coag) แบบยาว
จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

รวม ๓ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

พร้อมนี้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและผู้เสนอราคา ได้ลงลายมือชื่อไว้

เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล)

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
(นายกฤษณ์ โสภณวิวัฒน์)

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง นางสาวปิยนารถ ด้านพรประเสริฐ กรรมการ
(นางสาวปิยนารถ ด้านพรประเสริฐ)

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง ผู้แทนขาย
(นายเปรม หวังทวีวงศ์)

๑ -

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม